

Государственная система санитарно-эпидемиологического
нормирования Российской Федерации

4.1. Методы контроля. Химические факторы

ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ (МЕГ)АКРИЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Методические указания

МУК 4.1.025-95

Издание официальное

Госкомсанэпиднадзор России

Москва

1995

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Разработаны Нижегородским НИИ гигиены и профпатологии Госкомсанэпиднадзора России (д.м.н. Тихомиров Ю.П., к.б.н. Комракова Е.А.).
2. Утверждены и введены в действие Председателем Госкомсанэпиднадзора России – Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28 марта 1995 года.
3. Введены впервые в качестве методических указаний.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

I.	Область применения. Общие вопросы.....	5
I.1.	Физико-химические свойства и токсикологическая характеристика (мет)акриловых соединений.....	6
I.2.	Требования безопасности.....	8
I.3.	Требования к квалификации оператора.....	8
I.4.	Очистка химической посуды.....	9
I.5.	Условия отбора проб.....	9
I.6.	Нормы погрешностей измерений. Контроль погрешности измерений	12
I.7.	Методы и средства измерений и подготовки проб	12
I.8.	Условия выполнения измерений	20
2.	Контроль (мет)акриловых соединений соединений в атмосферном воздухе населенных мест	21
2.1.	Определение акриловой и метакриловой кислот (отбор на твердый сорбент)	21
2.2.	Определение акриловой и метакриловой кислот (отбор в растворитель)	26
2.3.	Определение метакрилата и метилметакрилата	29
2.4.	Определение бутилакрилата и бутилметакрилата	34
2.5.	Определение 2-этиленгексилакрилата	38
3.	Контроль (мет)акриловых соединений в воде водоемов хозяйственно-питьевого водопользования	42
3.1.	Определение акриловой и метакриловой кислот	42
3.2.	Определение метакрилата и метилметакрилата	48
3.3.	Определение бутилакрилата и бутилметакрилата	54
3.4.	Определение 2-этилгексилакрилата	58
4.	Контроль (мет)акриловых соединений в почве	62
4.1.	Определение акриловой и метакриловой кислот	62
4.2.	Определение метилакрилата и метилметакрилата	68

4.3. Определение бутилакрилата и бутилметакрилата	74
Список литературы	78

УТВЕРЖДАЮ



Председатель Госкомсанэпиднадзора
России, Главный государственный
санитарный врач Российской
Федерации

Е. Н. Беляев

" 28 " марта 1995г.

МУК 4.1.025—95

Дата введения: с момента утверждения

4.1. Методы контроля. Химические факторы
ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ (МЕТ) АКРИЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Методические указания

I. Область применения. Общие вопросы

Методические указания по измерению концентраций (мет) акриловых соединений в объектах окружающей среды предназначены для центров госсанэпиднадзора, санитарных лабораторий промышленных предприятий лабораторий научно-исследовательских институтов.

Методические указания разработаны и утверждены с целью обеспечения контроля соответствия фактических концентраций (мет) акриловых соединений в атмосферном воздухе, воде водоемов и почве к установленным уровням предельно допустимых концентраций, оценки эффективности внедренных санитарно-гигиенических мероприятий и влияния (мет) акриловых соединений на состояние здоровья населения.

Методы контроля подготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 8.207-76 "Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения" и ГОСТ 8.010-90 "Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к построению, содержанию и изложению документации, регламентирующей методики выполнения измерений содержания компонентов проб веществ материалов".

Издание официальное

© Госкомсанэпиднадзор России

Включенные в настоящий документ методы контроля одобрены Проблемной комиссией "Научные основы экологии человека и гигиены окружающей среды" РАМН и Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Госкомсанэпиднадзоре России. Часть методик по анализу атмосферного воздуха населенных мест была ранее утверждена бывшим Минздравом СССР, а по анализу воды водоемов была рекомендована к практическому применению Центром специализированной инспекции Минприроды России.

1.1. ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (МЕТ) АКРИЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Акриловая (АК) и метакриловая (МАК) кислоты, а также их эфиры метакрилат (МА), бутилакрилат (БА), 2-этилгексилакрилат (2-ЭГА), метилметакрилат (ММА) и бутилметакрилат (БМА) – бесцветные жидкости с резким раздражающим запахом, хорошо растворимые в органических растворителях, легко полимеризуются, в воздухе находятся в виде паров.

Краткие сведения о физико-химических и токсических свойствах (мет)акриловых соединений приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1
Физико-химические и токсические свойства (мет)-акриловых соединений

Вещество	Структурная формула	Молекулярная масса	Плотность	Темп кипения	Темп плавления	Удельный вес паров	Токсические свойства
АК	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COOH}$	72,05	1,047	141,3	60	3,0	сильное раздражающее общетоксическое действие
МА	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COO}-\text{CH}_3$	86,09	0,957	79,9	5,48	68,2	
БА	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COO}-\text{C}_4\text{H}_9$	128,17	0,901	147,4	0,32	4,5	

Продолжение таблицы I.1.

	3	4	5	6	7	8
2-ЭГА $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COO}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{C}_4\text{H}_9)$ C_2H_5	184,16	0,881	218	0,01	3,3	
МАК $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{COOH}$	83,05	1,015	161,0	60	260	Наркоти-
ММА $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{COO}-\text{CH}_3$	100,12	0,940	100,0	1,59	29,0	ческое
БМА $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{COO}-\text{C}_4\text{H}_9$	142,20	0,894	163,0	0,50	1,4	действие

Акриловые и метакриловые соединения относятся к числу химических веществ, которые по требованию Агентства по охране окружающей среды (США) должны подвергаться контролю на токсичность и за содержанием их в атмосферном воздухе и питьевой воде [20]. (Мет) акриловые соединения при ингаляционном и пероральном путях поступления в организм проявляют политропный характер действия - рефлекторное общетоксическое и эмбриотоксическое [12]. Общетоксическое действие характеризуется влиянием на нервную систему, обменные процессы, на функцию печени и периферический состав крови. По развитию хронической интоксикации акриловая и метакриловая кислоты, этилакрилат, метилакрилат, 2-этилгексилакрилат, бутилметакрилат отнесены ко II - III классам опасности, а бутилакрилат и метилметакрилат к I классу опасности. С учетом лимитирующего признака вредности разработаны и утверждены ПДК в атмосферном воздухе и в воде водоёмов для АК и МАК, ЭА, БА, МА, БМА, ММА (см. таблицу I.2).

Таблица I.2.

ПДК (мет)акриловых соединений

Вещество:	: Величина ПДК в атмосферном воздухе, мг/м ³		: Величина ПДК для воды водоёма хозяйственно-питьевого водопользования мг/дм ³
	: максим. разовая	: средне-суточная	
АК	0,1	0,04	0,5
МА	0,01	0,01	0,02
БА	0,0075	-	0,01
2-ЭГА	0,01	-	0,02
МАК	0,03	0,01	1,0

Продолжение таблицы I.2

I	2	3	4
ММА	0,10	0,01	0,01
БМА	0,04	0,01	0,02

I.2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

К проведению работ по отбору и анализу проб воздуха, воды и почвы допускаются лица, изучившие правила по технике безопасности, предусмотренные инструкцией "Основные правила безопасной работы в химической лаборатории", утверждённые Минхимпромом СССР от 27.07.77 г., проведением дополнительного инструктажа, учитывающего специфику проводимых работ. Все работы с (мет)акриловыми соединениями должны выполняться в вытяжном шкафу. Посуда должна обрабатываться в вытяжном шкафу хромовой смесью. Оператор должен быть ознакомлен с мерами предосторожности при работе с металлической ртутью. Заполнять капиллярный поршневой дозатор ртутью при его калибровке следует только на металлическом противне внутри вытяжного шкафа. По окончании заполнения дозатора пролитые капельки ртути тщательно собирают при помощи стеклянной ловушки с резиновой грушей, затем проводят демеркуризацию загрязненной поверхности 3%-м раствором марганцевокислого калия, подкисленного соляной кислотой или 20%-м раствором хлорного трёхвалентного железа.

Оператор должен быть подробно ознакомлен со специфическими свойствами акриловых соединений и металлической ртути и действием их на организм.

Для проведения измерений на газовом хроматографе оператор должен быть ознакомлен с правилами работы с электрическими установками, имеющими высокое напряжение, сосудами, находящимися под давлением.

I.3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРА.

К работе по выполнению измерений и обработке результатов допускают лиц со специальным химическим образованием, имеющих опыт работы на газовом хроматографе.

1.4. ОЧИСТКА ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ.

Стеклопнная посуда должна быть тщательно вымыта хромовой смесью, которую лучше предварительно слегка подогреть. Посуду выдерживают залитой хромовой смесью в течение 1-3-х часов, затем тщательно отмывают от следов соединений хрома и серной кислоты в проточной воде. Хорошо вымытую посуду обязательно 2 - 3 раза тщательно ополаскивают дистиллированной водой. Окончательную очистку посуды завершают пропариванием. Обработку паром продолжают до тех пор, пока стенки очищаемой посуды не будут равномерно смачиваться водой. Если этого не наблюдается, то посуду следует вымыть заново. Вымытую химическую посуду сушат в сушильном шкафу при температуре 80-100⁰С. Мерную посуду сушить при нагревании нельзя.

1.5. УСЛОВИЯ ОТБОРА ПРОБ.

1.5.1. Отбор проб воздуха.

Отбор проб воздуха осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.01-86 и ГОСТ 17.2.6.01-86 7,8. (мет)акриловые соединения из воздуха улавливают в основном на твердые сорбенты, помещенные в специальные сорбционные трубки. Предложен также способ улавливания (мет)акриловых кислот в дистиллированную воду. Параметры отбора проб, такие как расход воздуха и продолжительность аспирации, установлены в зависимости от объемов удерживания определяемых веществ улавливающей системой и необходимых пределов их измерения.

Для отбора проб используются электроаспираторы модели 822 или типа ЭА-1А. До начала отбора необходимо убедиться в соблюдении ряда требований.

На точность определения объема воздуха, прошедшего через сорбент, влияет нарушение герметичности воздухопроводов. Проверка состояния аспирирующей системы проводится не реже одного раза в месяц. Наиболее вероятно затекание воздуха через подводящие резиновые шланги за счет старения резины и появления трещин, соединения резиновых шлангов со штуцерами.

При отборе проб воздуха напряжение электропитания электроаспиратора должно составлять 220В ± 10%. Отбор проб произво-

дится при температуре наружного воздуха в диапазоне $-35 + 45^{\circ}\text{C}$.

Воздушные коммуникации один раз в месяц очищают от пыли и промывают теплой мыльной водой, чистой водой, затем спиртом. Воздуховод тщательно просушивают. Промытую систему перед отбором продувают воздухом в течение не менее 20 мин.

Проверка градуировки ротаметров электроаспираторов проводится не реже одного раза в месяц.

Все воздуховоды до сорбционной трубки должны быть приготовлены из фторопласта или стекла. Соединение сорбционных трубок производится в стык с помощью коротких резиновых трубок. Общая длина резиновых соединений, с которыми непосредственно соприкасается анализируемый воздух, не должна превышать 10 мм. Сорбционные трубки устанавливают при отборе конусным концом к потоку воздуха, чтобы он проходил через сорбент в направлении, противоположном потоку газа-носителя при анализе пробы.

Сразу после отбора проб сорбционные трубки закрывают заглушками и помещают в эксикатор. После транспортировки проб в лабораторию и до проведения анализа эксикатор с пробами содержат в холодильнике. Допускается хранение отобранных проб в холодильнике не более недели.

1.5.2. Отбор проб воды.

Отбор проб воды, приборы и устройства для отбора проб воды должны соответствовать требованиям ГОСТ 17.1.5.04-81 и ГОСТ 27.6-1 - 84 [3,4]. В практике работы санитарной службы в настоящее время используют в основном ручные пробоотборники и барометры различных конструкций.

При отборе проб воды используют посуду из бесцветного химически стойкого стекла. Посуда должна быть тщательно вымыта. Для этой цели применяют хромовую смесь, которую затем тщательно смывают проточной и дистиллированной водой, затем посуду обрабатывают водяным паром. Перед отбором пробы посуду несколько раз тщательно ополаскивают исследуемой водой. Используют тщательно вымытые стеклянные пробки.

Пробы транспортируют в таре и упаковке, гарантирующих сохранность и предохраняющих воду от замерзания или перегрева.

1.5.3. Отбор проб почвы. Подготовка проб к анализу.

Отбор проб почвы и подготовка их к анализу осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02.84 /67.

Для отбора проб на исследуемой территории намечают 2 участка площадью 20 м² каждый: один вблизи источника загрязнения (опытный), другой вдали от него - (контрольный).

Контрольный участок должен быть заведомо незагрязненным (мет)акриловыми соединениями. На выделенном участке намечают 5 точек для забора проб. Точки отбора располагаются на выделенном участке по "конверту" (одна в центре и четыре по углам). Каждая точка представляет собой центр выбранного для исследования одного квадратного метра территории. В каждой точке выкапывают приямок (шурф) сечением 0,3 x 0,3 м и глубиной 0,2 м. Поверхность одной из стенок шурфа очищают ножом. Затем на этой стенке вырезают почвенный образец размером приблизительно 20 x 5 x 2, чтобы величина навески составляла около 200 г. Общая масса (средней) пробы должна составлять не менее 1 кг.

Пробы почвы помещают в стеклянные банки с крышкой и транспортируют в лабораторию.

Из поступивших образцов почвы готовят сначала лабораторные пробы. Образец почвы тщательно перемешивают на листе фанеры или картона. Выбирают из него инородные включения - камень, дерево, бумагу, стекло. Затем просеивают через сито с отверстиями 3 мм. Просеянную почву рассыпают ровным слоем толщиной 2 мм в форме квадрата или прямоугольника. Почву делят по диагонали линейкой или металлической крестовиной на 4 прямоугольника. Почву из двух противоположных угольников отбрасывают или оставляют в запасе, а оставшуюся, вновь перемешивают, опять распределяют тонким слоем и снова делят, в результате чего остаётся около 400 г. почвы.

Для приготовления аналитической пробы почвы лабораторную пробу измельчают в ступке, просеивают через сито с отверстиями 1 мм и сыпают в банки с плотно закрывающимися крышками.

1.6. НОРМЫ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ. КОНТРОЛЬ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ.

Описанные в сборнике методики измерения концентраций (мет) акриловых соединений метрологически аттестованы в соответствии с ГОСТ 8.207-76 [2].

Суммарная погрешность измерения массовой концентрации определяемого вещества в анализируемой среде не превышает $\pm 25\%$ во всем диапазоне измеряемых концентраций.

В каждой методике указано наибольшее значение суммарной погрешности.

Контроль точности измерений производится в соответствии с РД.52.24.66-86 [4].

1.7. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ПОДГОТОВКИ ПРОБ.


Измерения концентраций (мет) акриловых соединений включают методики газожидкостной хроматографии с предварительным концентрированием веществ из анализируемой среды.

1.7.1. Хроматографический анализ.

Хроматографический анализ проводят на газовом хроматографе серии "Цвет-100" с пламенно-ионизационным детектором. В качестве газа-носителя используют азот. Для анализа кислот газ-носитель насыщают парами муравьиной кислоты с целью подавления необратимой адсорбции определяемых кислот в хроматографической колонке, а также коммуникациями термостата прибора. Для этого перед входом в термостат хроматографа в линию газа-носителя устанавливают сосуд с 5-7 мл муравьиной кислоты (рис.1.1.).

Хроматографирование проводят на насадочных колонках с различными сорбентами, что повышает надёжность разделения и идентификации определяемых веществ [8]. Используют трехметровые металлические и стеклянные колонки с диаметром 3-4 мм. Перед заполнением насадочной колонки промывают последовательно водой, ацетоном и гексаном, а затем высушивают в токе воздуха. При заполнении колонки насадочной в колонку со стороны, подключаемой к детектору, вкладывают пробку из стекловолокна и подсоединяют этот конец колонки к вакуумному насосу. Постукивая по колонке, заполняя-

Схема насыщения газа-носителя парами муравьиной кислоты

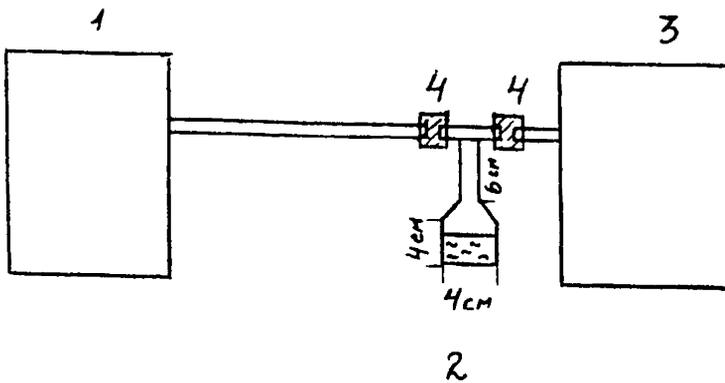

1 - источник газа-носителя, 2 - сосуд с муравьиной кислотой, 3 - термостат хроматографа, 4 - шланговые соединения

Рис. 1.1.

ют её через воронку насадкой. Насадку закрепляют в колонке пробкой из стекловолокна.

Идентификацию (мет) акриловых соединений в анализируемой пробе проводят по времени их удерживания на колонках с различными насадками.

1.7.2. Количественное определение.

Количественное определение проводят методом абсолютной градуировки, которую осуществляют по искусственным градуировочным растворам и образцам, а также парогазовым смесям (ПГС) 167.

Градуировочные растворы готовят весовым методом в калибровочных колбах. Вещество вносят в колбу по каплям. Предварительно в колбу не менее чем до половины наливают растворитель и взвешивают на аналитических весах. Для внесения вещества используют пипетку с оттянутым концом. Навеску вещества вносят в мерную колбу таким образом, чтобы оно сразу попадало в растворитель. Определяют массу введенной жидкости по увеличению массы колбы, рассчитывают концентрацию полученного раствора и последующим разведением готовят растворы требуемых концентраций.


Градуировочные образцы почвы получают на основе контрольной почвы введением в неё заданных количеств определяемых веществ в виде их растворов. В качестве контрольной используют почву, отобранную в зоне, где исключается попадание в почву определяемых веществ. Контрольная почва исследуется на содержание определяемых веществ, затем высушивается на листах бумаги в тени до воздушно-сухого состояния. Затем из неё готовят аналитическую пробу (см. п.п. 15. 3)

Для создания калибровочных ПГС применяют капиллярные диффузионные дозаторы — поршневые и ампульные, принцип действия которых основан на медленном введении дозируемого потока в струю газа-носителя. 11, 13, 197. Дозаторы изображены на рис. 1.2.

Поршневой дозатор представляет собой калиброванный капилляр, в котором высота столба дозируемой жидкости регулируется с помощью поршня из фторопласта.

Над капилляром пропускается газ-носитель с определенной скоростью. Схема установки для создания ПГС с помощью диффузионного дозатора приведена на рис. 1.2.

Схема установки для создания парогазовой смеси

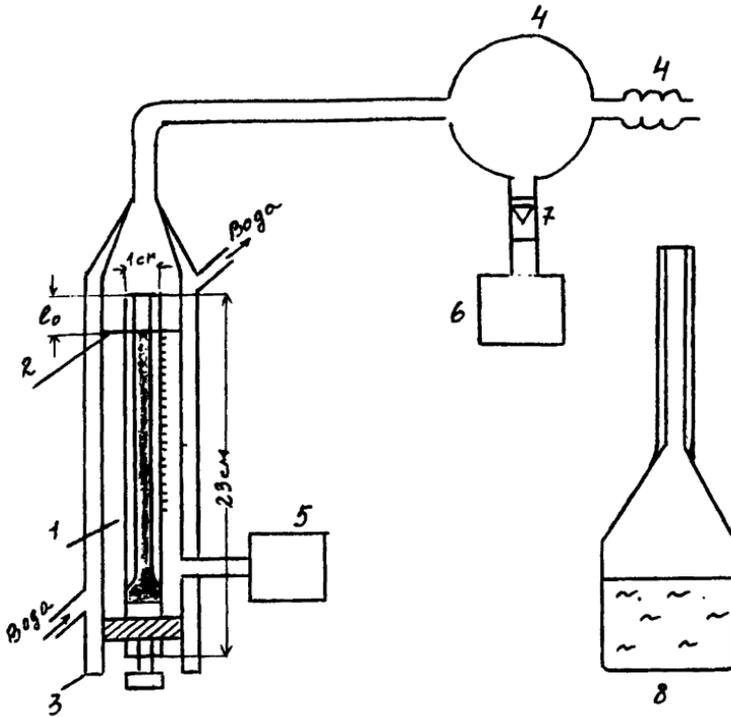

1 - поршневой капиллярный диффузионный дозатор, 2 - микрометр, 3 - термостатирующая водяная рубашка; 4 - смеситель, 5 - компрессорная установка для разбавления ПГС, 6 - источник газа-носителя, 7 - ротаметр, 8 - ампульный дозатор

Рис. 1.2.

Для определения сечения капилляра в него вводят ртуть, измеряют длину её столба в капилляре, а затем взвешивают ртуть в бюксе. Сечение капилляра S /см²/ вычисляют по формуле:

$$S = \theta / \rho L \quad (2)$$

где θ - масса ртути, г;
 ρ - плотность ртути при температуре измерения, г/см³;
 L - длина столбика ртути, см.

Для градуировки капилляра его заполняют дозируемым (мет)акрилатом. С помощью микрометра измеряют изменение уровня мениска жидкости за определённые промежутки времени. Диффузионный поток J (мг/мин) рассчитывают по формуле:

$$J = S \rho \Delta \ell / t \quad (3)$$

где ρ - плотность дозируемого вещества, г/см²;
 t - время, за которое мениск жидкости пройдет из положения ℓ_0 в положение ℓ , мин; ℓ_0 - расстояние от верхнего конца капилляра до мениска жидкости, см. (см. рис. 1.2.).

Ампульный дозатор градуируют гравиметрическим методом. Строят график зависимости изменения массы дозируемого вещества от времени и определяют диффузионный поток I (мг/мин):

$$J = \Delta \theta / t \quad (4)$$

где θ - изменение массы дозируемого вещества, мг;
 t - время, мин.

Концентрацию вещества (мг/л) вычисляют по формуле:

$$C = \frac{I \cdot V}{V} \quad (5)$$

где V - скорость потока газа-носителя, л/мин.

Для создания низких значений концентраций вещества ПГС разбавляют с помощью компрессорной установки.

1.7.3. Концентрирование (мет)акриловых соединений из воздуха.

Улавливание (мет)акриловых соединений из воздуха осуществляют на твердый сорбент при температуре окружающей среды. В качестве концентрирующего сорбента для кислот и 2-ЭГА используют хезасорб АМ - НМДС, содержащий 5% SE-30.

Для улавливания метиловых и бутиловых эфиров акриловых кислот применяют сорбент с более развитой поверхностью силохром С-80, содержащий 5% ПМС-100.

Сорбент помещают в специальные трубки, изготовленные таким образом, чтобы проводить термодесорбцию непосредственно в испарителе хроматографа. С этой целью газонаправляющую трубку испарителя заменяют на втулку, фиксирующую сорбционную трубку. Сорбционная трубка в втулке, состыкованные с помощью конусного шлифа, имитируют стандартную газонаправляющую трубку. Схема устройства для термодесорбции в испарителе хроматографа приведена на рис. 1.3.

Конец сорбционной трубки, который поджимается гайкой испарителя, имеет сквозное отверстие для газа-носителя. После введения сорбционной трубки в испаритель время стабилизации нулевой линии не превышает 1,5 мин., что не отражается на качестве измерений по шкале электрометра $20 \cdot 10^{-12}$ А. Вынимают сорбционную трубку из испарителя с помощью пинцета.

В качестве заглушек для трубок используют кусочки резиновых шлангов со стеклянными пробками. Очищают резиновые шланги со стеклянными пробками кипячением в дистиллированной воде.


Для анализа атмосферного воздуха отбирают 1-3 л исследуемого воздуха со скоростью 0,1 - 0,2 дм³/мин в течение 10-15 мин.

1.7.4. Концентрирование (мет)акриловых соединений из воды.

Для извлечения из воды малорастворимых эфиров используют метод газовой экстракции, заключающийся в барботировании инертного газа-экстрагента через пробу воды [17]. В качестве барбатера применяют поглотительный прибор, газа-экстрагента - азот из баллона. Скорость подачи азота контролируют реометром, калиброванным с помощью пенного расходомера, время барботирования - по секундомеру. Схема установки газовой экстракции представлена на рис. 1.4. Экстрагированные вещества улавливают в сорбционных трубках. Сконцентрированные в трубках примеси извлекают термодесорбцией в испарителе хроматографа.

Для концентрирования кислот в воде используют метод упаривания. Процесс упаривания пробы осуществляют в фарфоровых чашках на электрической плитке малыми порциями, поддерживая режим легкого кипения без разбрызгивания упариваемой жидкости. Упаривают кислоты в виде их солей, после проведения концентрирования соли вновь переводят в кислоты.


Устройство для термодесорбции в испарителе хроматографа

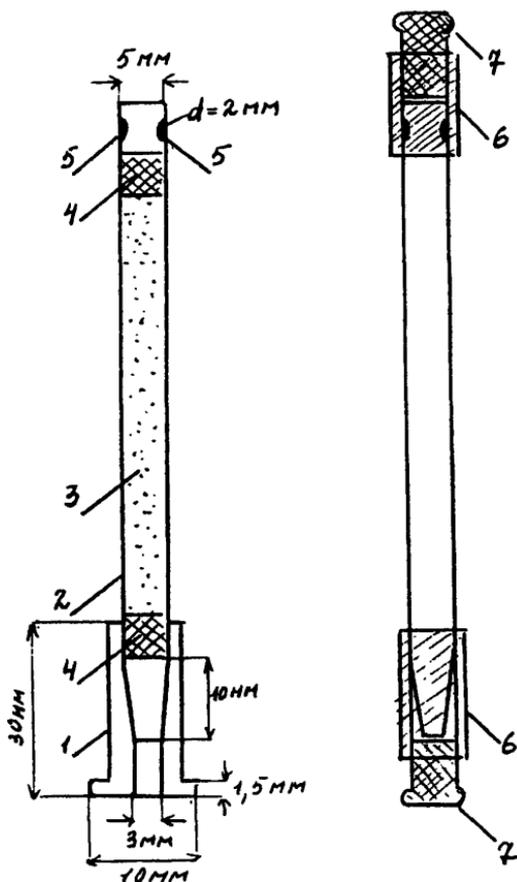

1 - расширяющая ступка, 2 - сорбционная трубка, 3 - сорбент, 4 - пробка из стекловолокна, 5 - отверстия для газа-носителя, 6 - резиновый шланг заглушки, 7 - стеклянная пробка заглушки

Рис. 1.3.


Схема установки для газовой экстракции

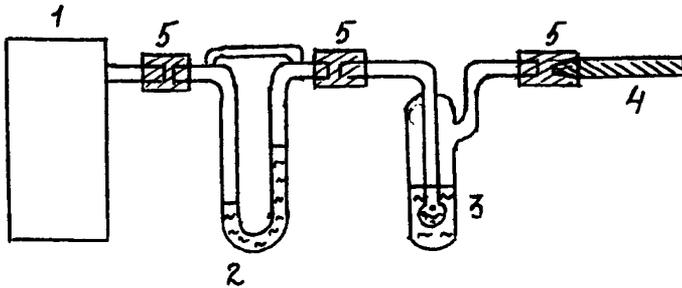

1 - источник газа-экстрагента, 2 - реометр, 3 - барботер (поглотительный прибор с шариковым распылителем), 4 - сорбционная трубка, 5 - шланговые соединения

Рис. I.4.

Разъемный барботер

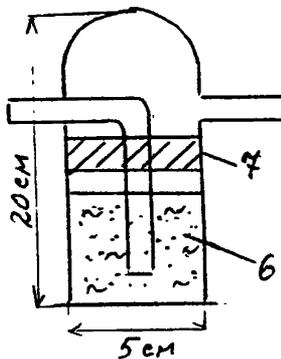

6 - разбавленная водой проба почвы, 7 - шпатель

Рис. I.5.

1.7.5. Концентрирование (мет)акриловых соединений из почвы.

Акриловую и метакриловую кислоты извлекают из почвы экстрагентом, содержащим в своём составе дистиллированную воду. Затем экстракт упаривают, переводя предварительно кислоты в соли.

Для концентрирования эфиров из почвы используют как и в случае проб воды метод газовой экстракции с улавливанием извлеченных примесей на твёрдый сорбент. Пробу почвы для проведения газовой экстракции помещают в разбёмный барбатер, изображенный на рис. 1.5. Для процесса барботирования газа-экстрагента через пробу её разбавляют дистиллированной водой.

1.8. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ.

При выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:

- температура воздуха, °С	20 ± 5
- атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст.)	84,0 - 106,7 (630 - 800)
- влажность воздуха при температуре 25°С, %	не более 80

2. КОНТРОЛЬ (МЕТ) АКРИЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ.

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКРИЛОВОЙ И МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТ (ОТБОР НА ТВЕРДЫЙ СОРБЕНТ).

Методика предназначена для измерения массовых концентраций АК и МАК в атмосферном воздухе в диапазоне 0,005 – 0,5 мг/м³.

Определению не мешают: БА, БМА, 2-ЭГА, уксусная и пропионовая кислоты, ароматические углеводороды.

2.1.1. Погрешность измерения.

Суммарная погрешность измерения АК не превышает 22%, МАК – 20%.

2.1.2. Метод измерения.

Определение основано на газохроматографическом измерении концентраций акриловой и метакриловой кислот, улавливаемых на твердый сорбент кезасорб АW-НМД с 5% SE-30.

2.1.3. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы.

2.1.3.1. Средства измерений.

Хроматограф лабораторный газовый серии "Цвет-100" с пламенно-ионизационным детектором.

Весы аналитические ВЛА-200	ГОСТ 24104-80E
Меры массы	ГОСТ 7328 -82E
Электроаспиратор 822	ГОСТ 12.2.025-76
или электроаспиратор ЭА-1	ТУ 25-II-1414-78
Секундомер, класс 3	ГОСТ 5072 - 79 E
Термометр ТМ-8;	
пределы измерения от - 35 до 40°C	ГОСТ 112 - 78E
Барометр апероид М-67	ТУ 2504-1797-75
Линейка измерительная	ГОСТ 427 - 56

2.1.3.2. Вспомогательные устройства.

Редуктор кислородный ТУ 26-05-235-70

Редуктор водородный ТУ 26-05-463-76

Дозаторы диффузионные
капиллярные ампульные (рис. I.2).

Аппарат для перегонки

Компрессорная установка
типа УК-25/1,6 ТУ 64-1-2748-74или компрессорная уста-
новка типа УК ТУ 22-5871 - 84Втулка для фиксации в испарителе
сорбционных трубок (см. рис. I.3)

Трубки сорбционные (см. рис. I.3).

Колонка хроматографическая стеклянная 300 x 0,3 см
ГОСТ 22056 - 76

Сосуд для муравьиной кислоты (см. рис. I.1.)

2.1.3.3. М а т е р и а л ы

Трубка резиновая ГОСТ 5496 - 57

Стекловолокно

2.1.3.3. Р е а к т и в ы

Акриловая кислота, ч МРТУ 6-09-5886-69

очищенная перегонкой

Метакриловая кислота, ч

очищенная перегонкой

МРТУ 6-02-1768-64

Твердый носитель хрома-
тон N-AW-НМДС, (0,20-0,25 мм)

Хроматографический сорбент

AW-НМДС (0,25-0,30 мм), пропитанный

5% SE - 30

Жидкая фаза полиэтиленгликольадипинат (ПЭГА), ч.д.а
ТУ СИ-65-67

Хлороформ х.ч.

ГОСТ 3160 - 51

Муравьиная кислота, ч.д.а,

ГОСТ 5848 - 60

Азот газообразный

ГОСТ 9293 - 74

Водород газообразный

ГОСТ 3022 - 77

Воздух от компрессора или

ГОСТ И1882 - 73.

сжатый в баллонах

2.1.4. Подготовка к выполнению измерений.

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие операции:

- подготовка испарителя хроматографа
- подготовка газа-носителя
- подготовка хроматографической колонки
- подготовка сорбционных трубок

2.1.4.1. Подготовка испарителя хроматографа.

Из испарителя хроматографа вынимают газонаправляющую трубку и устанавливают втулку для фиксации сорбционных трубок.

2.1.4.2. Подготовка газа-носителя.

В линию газа-носителя (азот) перед входом в термостат хроматографа устанавливают сосуд с муравьиной кислотой (рис. 1.1.)

2.1.4.3. Подготовка хроматографической колонки.

Готовят хроматографическую насадку 10% ПЭГА на хроматоне. 1 г жидкой фазы ПЭГА растворяют в подогретом хлороформе и заливают раствором 10 г хроматона, смесь встряхивают и оставляют до полного испарения растворителя. Готовой насадкой заполняют стеклянную трехметровую колонку, устанавливают её в термостате хроматографа без подсоединения к детектору и кондиционируют в течение 8 час. при постепенном повышении температуры от 50 до 180°C. Затем колонку подсоединяют к детектору и записывают нулевую линию на шкале электрометра $20 \cdot 10^{-12} \text{A}$.

2.1.4.4. Подготовка сорбционных трубок.

В сорбционную трубку с одного конца помещают пробку из стекловолокна высотой около 1 см, засыпают при постукивании 0,7 г сорбента $\text{AW} - \text{HMD}_2\text{S}$, обработанный 5% SE-30 и фиксируют его также пробкой из стекловолокна. Подготовленные сорбционные трубки поочередно кондиционируют в испарителе хроматографа при 220°C в течение 2 ч. Охлажденные трубки закрывают заглушками с обоих концов и помещают в эксикатор.

2.1.4.5. Условия проведения хроматографического анализа.

Для проведения анализа устанавливают следующий режим прибора:

Температура °C

испарителя

220

23

колонки	130
скорость потока, см ³ /мин	
азота	40
водорода	40
воздуха	400
скорость протяжки	
диаграммной ленты, мм/ч	240

2.1.4.6. Установление градуировочной характеристики.

Для установления градуировочной характеристики создают ПГС АК и МАК с помощью капиллярных диффузионных ампульных дозаторов.

Для создания ПГС АК используют дозатор с внутренним диаметром капилляра около 0,1 см и высотой 3,0 см, для МАК — соответственно 0,2 см и 3,0 см. Диффузионный поток пропускают со скоростью 0,05 дм³/мин, разбавляющий варьирует от 0,1 до 10,0 дм³/мин. Дозаторы термостатируют при 20⁰С. Создают по 4 серии ПГС не менее 6–7 концентраций в диапазоне 0,005 – 0,5 мг/м³. На сорбционные трубки отбирают по 2 дм³ ПГС каждой концентрации. Проводят не менее 5 параллельных измерений каждой концентрации в каждой серии ПГС и результаты заносят в табл. 2.1.

Таблица 2.1.

Результаты определения градуировочной характеристики.

Вещество:	Кол-во вещества:	Шкала электрометра,	Площадь пика,	Среднее значение	Градуировочный коэффициент
	мкг,	A	см ²	площади пика,	K = $\frac{q}{h}$
	g		h _i	см ² ,	мкг/см ²
				h	

2.1.4.7. Отбор проб.

Через сорбционную трубку аспирируют воздух со скоростью 0,1 дм³/мин в течение 20 мин. По окончании отбора трубку заглушают и помещают в эксикатор. Отбирают не менее 2-х параллельных проб.

2.1.5. Выполнение измерений.

При выполнении измерений концентраций АК и МАК в пробах воздуха выполняют следующие операции.

Выводят прибор на рабочий режим по п.п.2.1.4.5. Сорбционную трубку с пробой вставляют в испаритель хроматографа, включают секундомер и диаграммную ленту. Затем проводят измерение второй параллельной пробы.

2.1.6. Обработка результатов измерений.

Обработку результатов измерений концентраций АК и МАК выполняют следующим образом: на хроматограмме измеряют площади пиков АК и МАК для двух параллельных проб; усредняют их значения и рассчитывают концентрации кислот по формуле:

$$C = \frac{K \cdot \bar{S}_{1,2}}{V} \quad \text{мг/м}^3$$

для шкалы электрометра;

где K - градуировочный коэффициент, на которой зафиксирован пик, мкг/см^2 ;

$\bar{S}_{1,2}$ - усреднённое значение площадей пиков, см^2 ($n = 2$)

V - объём пробы воздуха, приведённый к нормальным условиям, дм^3 (0°C , 101080 Па)

$$V = 273p \cdot V_t / (273 + t) 101080$$

где p - атмосферное давление при отборе пробы, Па ;

t - температура воздуха в месте отбора пробы, $^\circ\text{C}$;

V_t - объём воздуха в месте отбора пробы при температуре t $^\circ\text{C}$, дм^3 .

2.1.7. Оформление результатов измерений.

Результаты измерений оформляют записью в журнале по форме, приведённой в табл. 2.2.

Таблица 2.2.

Результаты измерений

Кислота:	Дата отбора:	Проба:	Шкала электрометра, А	Градуировочный коэффициент, K , мкг/см^2	Площадь пика, см^2 , S_i	Среднее значение пл. пика, $\bar{S}_{1,2}$, см^2	Концентрация, C , мг/м^3
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:

2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКРИЛОВОЙ И МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТ (ОТБОР В РАСТВОРИТЕЛЬ)

Методика предназначена для измерения массовых концентраций АК и МАК в атмосферном воздухе в диапазоне 0,04 - 5,0 мг/м³.

Определению не мешают: БА, БМА, 2-ЭГА, уксусная и пропионовая кислота, ароматические углеводороды.

2.2.1. Погрешность измерения.

Суммарные погрешности измерения концентраций А^А и МАК не превышают соответственно 21% и 20%.

2.2.2. Метод измерения.

Определение кислот основано на газохроматографическом измерении концентраций веществ, уловленных в дистиллированную воду.

2.2.3. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы.

2.2.3.1. Средства измерений.

Хроматограф лабораторный газовый серии "Цвет-100" с пламенно-ионизационным детектором.

Весы аналитические ВЛА-200

ГОСТ 24104-80Е

Меры массы

ГОСТ 7328-62Е

Электроаспиратор ЭА-1

ТУ 25-II-1414-78

или электроаспиратор 822

ГОСТ 12.2.025-76

Секундомер, класс 3

ГОСТ 5072 - 79Е

Термометр ТМ-8

пределы измерения -35 до + 40°С

ГОСТ 112-78Е

Барометр aneroid М-67

ТУ 2504-1797-75

Микрошприц МШ-10

ТУ 2.833.106

Пипетки 2-2-5

ГОСТ 20292-74Е

Линейка измерительная

ГОСТ 427 - 56

2.2.3.2. Вспомогательные устройства.

Редуктор кислородный

ТУ 26-05-235-70

Редуктор водородный

ТУ 26-05-463-76

Дозаторы диффузионные капиллярные ампульные (рис. 1.4.)

Компрессорная установка тип УК-25/1,6, или УК	ТУ 64-I-2748-74 ТУ 22-587I-84
Колонка хроматографическая стеклянная 300x0,3 см	ГОСТ 22056-76
Поглотительные приборы с пористой пластинкой	ТУ-25-II-II36-75
Пробирки П 4-10-14/23xС	ГОСТ 25336 - 62
Груша резиновая	ГОСТ 5496

2.2.3.3. М а т е р и а л ы

Трубка резиновая, тип I	ГОСТ 5496-57
Стекловолокно	

2.2.3.4. Р е а к т и в ы

Акриловая кислота, ч, очищенная перегонкой	МРТУ 6-09-5886-69
Метакриловая кислота, ч, очищен- ная перегонкой	МРТУ 6-02-1768-64
Твёрдый носитель хроматон M-AW- НМД δ , (0,20-0,25мм)	
Жидкая фаза ПЭГА, ч.д.а.	ТУ 6П-65-67
Хлороформ, х.ч.	ГОСТ 3160-5I
Муравьиная кислота, ч.д.а.	ГОСТ 5848-60
Дистиллированная вода	ГОСТ 6709-72
Азот газообразный	ГОСТ 9293 - 74
Водород газообразный	ГОСТ 3022 - 77
Воздух от компрессора или сжатый в баллонах	ГОСТ II882 - 73

2.2.4. Подготовка к выполнению измерений.

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие операции: подготовка газа-носителя, подготовка хроматографической колонки, установление режима хроматографа, определение градуировочной характеристики, подготовка пробоотборного устройства, отбор проб.

2.2.4.1. Подготовка газа-носителя см. п.2.1.4.2.

2.2.4.2. Подготовка хроматографической колонки см. п.2.1.4.3.

2.2.4.3. Установление рабочего режима хроматографа
см. п.2.1.4.4.

2.2.4.4. Установление градуировочной характеристики.

Для установления градуировочной характеристики создают ПГС как описано в п.2.1.4.6.

В поглотительные приборы с 2мл дистиллированной воды отбирают до 30 дм³ ПГС, содержащей различные количества кислот. Анализируют по 5 мкл поглотительного раствора. Проводят не менее 5 измерений каждой концентрации. Результаты измерений заносят в табл. 2.1.

2.2.4.5. Отбор проб.

Исследуемый воздух аспирируют через поглотительный прибор с 2мл дистиллированной воды со скоростью 0,2 дм³/мин в течение 15 мин. После проведения отбора поглотительные приборы заглушают. Отбирают не менее 2-х параллельных проб.

2.2.5. Выполнение измерений.

При выполнении концентраций АК и МАК в пробах воздуха выполняют следующие операции:

Выводят прибор на рабочий режим по п.п. 2.1.4.5.

Пробу из поглотительного прибора выливают в пробирку и анализируют 5 мкл. Делают не менее 3 измерений. Затем анализируют параллельную пробу.

2.2.6. Обработка результатов измерений.

Обработку результатов измерений концентраций АК и МАК выполняют следующим образом.

На хроматограмме измеряют площади пиков АК и МАК параллельных измерений, вычисляют среднее значение для каждой кислоты и рассчитывают концентрации по формуле:

$$C = \frac{K \cdot \bar{S} \cdot V_{np}}{V_a \cdot V_o} \quad (\text{мг/м}^3)$$

где K - градуировочный коэффициент, мг/см²;

\bar{S} - усредненное значение площади хроматографического пика, см²;

V_a - объём пробы, взятый для анализа, см³;

V_o - объём исследуемого воздуха, дм³, приведённый к нормальным условиям (см. п.2.1.7.).

V_{np} - объём пробы, см³.

2.2.7. Оформление результатов измерений.

См. п.2.1.7.

2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТИЛАКРИЛАТА И МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА.

Методика предназначена для измерения массовых концентраций МА и ММА в атмосферном воздухе в диапазоне 0,002 - 0,2 мг/м³.
 Определению не мешают: ацетон, метанол, изопропанол, бутанол, акрилонитрил, этилацетат, БА, БМА, 2-ЭГА, АК, МАК.

2.3.1. Нормы погрешности измерения.

Значения суммарных погрешностей измерения концентраций МА и ММА не превышают 22%.

2.3.2. Метод измерения.

Определение МА и ММА основано на газохроматографическом измерении концентраций веществ, уловленных на твердый сорбент.

2.3.3. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы.

При выполнении измерений применяются следующие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы.

2.3.3.1. Средства измерений см. п. 2.1.3.1.

2.3.3.2. Вспомогательные устройства

Редуктор кислородный	ТУ 26-05-235-70
----------------------	-----------------

Редуктор водородный	ТУ 26-05-463-76
---------------------	-----------------

Дозаторы диффузионные капиллярные поршневые (рис. 1.2).

Реометр стеклянный лабораторный типа РДС	ГОСТ 9932-61
--	--------------

Компрессорная установка типа УК-25/1,6,	ТУ-64-1-2748-74
---	-----------------

или компрессорная установка	ТУ 22-5871-84
-----------------------------	---------------

Колонки хроматографические, 300x0,3 см	ГОСТ 22056-76
--	---------------

Втулка для фиксации сорбционных трубок (рис. 1.3)

Сорбционные трубки (рис. I.3.)

Стакан химический вместимостью 100 мл	ГОСТ 25336-28
Аппарат для перегонки	
Чашки выпарительные вместимостью 100 мл	ГОСТ 9147-80
Эксикатор	ГОСТ 6371-73

2.3.3.3. М а т е р и а л ы

Трубка резиновая, тип I	ГОСТ 5496-57
Стекловолокно	

2.3.3.4. Р е а к т и в ы

Метилакрилат, ч. перегнанный	ТУ 8П-145-68
Метилметакрилат, хром. чистый	ТУ ИРЕА-29-66
Твердый носитель хроматон N-AW - НМДС, (0,20-0,25 мм) или хроматон N- "Суреч", или хроматон N-AW - ДМСЗ	
Твёрдый носитель, силохром С-80, (0,25-0,5 мм)	ТУ 6-09-17-48-74
Жидкая фаза дидецилфталат (ДДФ); ч	МРТУ 6-09-958-63
Жидкая фаза полиметилсилоксан ПМС-100, ч	МРТУ 6 № 4
Жидкая фаза полифенилметилсилоксан ПФМС-4, ч	ГОСТ 15866 - 70
Диэтиловый эфир, х.ч.	ГОСТ 6709-72
Азот газообразный	ГОСТ 9293 - 74
Водород газообразный	ГОСТ 3022 - 77
Воздух от компрессора или сжатый в баллонах	ГОСТ 11882-73

2.3.4. Подготовка к выполнению измерений.

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие операции:

- подготовка испарителя хроматографа
- подготовка хроматографических колонок
- подготовка сорбционных трубок
- установление рабочего режима хроматографа
- определение градуировочной характеристики
- отбор проб.

2.3.4.1. Подготовка испарителя хроматографа см. п. 2.1.4.1.

2.3.4.2. Подготовка хроматографических колонок.

Готовят две хроматографические насадки: насадка № 1 - 15% ДДФ на хроматоне и насадка № 2 - 10% ПМС - 100 + 20% ПМС-4 на хроматоне.

Для приготовления насадки № 1 2,25 г жидкой фазы ДДФ растворяют в диэтиловом эфире и заливают раствором 15 г хроматона, смесь встряхивают и оставляют до полного испарения эфира. Для приготовления насадки № 2 1 г жидкой фазы ПМС-100 и 2 г жидкой фазы ПМС-4 растворяют в эфире и раствором заливают 10 г хлороформа, смесь встряхивают и оставляют до полного испарения растворителя.

Насадкой № 1 заполняют две трехметровые колонки, соединяют их последовательно переходником и устанавливают в термостате хроматографа без подсоединения к детектору (колонка №1). Насадкой № 2 заполняют трехметровую колонку, устанавливают её в термостате хроматографа без подсоединения к детектору. Колонки кондиционируют в потоке газа-носителя в течение 8 час при постепенном повышении температуры от 50 до 120°C. После окончания кондиционирования колонки присоединяют к детектору и записывают нулевую линии в условиях анализа при шкале электрометра $20 \cdot 10^{-12}$ А.

2.3.4.3. Подготовка сорбционных трубок.

Жидкую фазу ПМС-100 в количестве 0,5 г растворяют в эфире, раствором заливают 10 г носителя силохром С-80, смесь тщательно перемешивают и оставляют до полного испарения эфира. Готовым сорбентом по 0,3 г заполняют сорбционные трубки. Сорбент в трубках с обоих концов фиксируют пробками из стекловолокна. Подготовленную сорбционную трубку вставляют в испаритель хроматографа, испаритель закрывают навинчивающейся гайкой с резиновым уплотнением и кондиционируют трубку в течение 2 час. при температуре 200°C. После кондиционирования трубку вынимают из испарителя пинцетом, охлаждают, заглушают и помещают в эксикатор.

2.3.4.4. Условия проведения хроматографического анализа.

Для проведения хроматографического анализа устанавливают следующий режим прибора:

Температура, °С

испарителя

200

термостата

колонок	90
Скорости потоков, см ³ /мин	
азота	40
водорода	40
воздуха	400
Скорость движения диаграммной ленты, мм/ч	240

2.3.4.5. Установление градуировочной характеристики.

Для установления градуировочной характеристики создают ПГС МА и ММА с помощью капиллярного поршневого дозатора с площадью сечения около 0,01 см². Дозатор термостатируют при 20°С. Газ-носитель пропускают со скоростью 0,1 дм³/мин. В сорбционные трубки отбирают по 1 дм³ ПГС различных концентраций во всем требуемом диапазоне измерения и проводят измерения в условиях анализа. Создают по 4 серии ПГС в диапазоне концентраций 0,002 – 0,2 мг/м³. Делают по 5 параллельных измерений каждой концентрации в каждой серии. На хроматограммах измеряют высоты пиков и результаты заносят в табл. 2.3.

Таблица 2.3.

Результаты определения градуировочной характеристики.

Вещество:	Кол-во вещества:	Шкала электрометра, А	Высота пика,	Среднее значение высоты пика,	Градуировочный коэффициент
	мкг,		см	пика,	цент
	<i>g</i>		<i>h_i</i>	\bar{h}	$K = \frac{g}{\bar{h}}$
				см	мкг/см

2.3.4.6. Отбор проб.

Сорбционную трубку конусным концом подсоединяют к аспиратору. Исследуемый воздух аспирируют через трубку 10 мин со скоростью 0,1 дм³/мин. По окончании отбора трубку заглушают с обоих концов

и помещают в эксикатор. Отбирают не менее 4-х параллельных проб. Отобранные в сорбционных трубках пробы до анализа сохраняют в эксикаторе не более 3-х суток. Если эксикатор с пробами хранить в холодильнике, то срок возможен до недели. Для проведения холостого опыта вместе с пробами хранят контрольные сорбционные трубки, которые затем анализируют также, как и пробы.

2.3.5. Выполнение измерений.

При выполнении измерений концентрации МА и ММА в пробах воздуха выполняют следующие операции:

Выводят прибор на рабочий режим в соответствии с п.2.3.4.6.

Сорбционную трубку с пробой вставляют в испаритель хроматографа, соединенный с колонкой № 1. Включают секундомер и диагностическую ленту. Проводят измерение второй параллельной пробы.

На колонке № 2 хроматографируют третью и четвертую параллельные пробы.

2.3.6. Обработка результатов измерений.

Обработку результатов измерений концентраций МА и ММА в пробах атмосферного воздуха выполняют следующим способом.

На хроматограммах, полученных при хроматографировании проб на различных колонках, идентифицируют пики МА и ММА и для обработки выбирают ту хроматограмму, где наблюдается наибольшая степень разделения определяемых веществ с сопутствующими примесями.

Измеряют высоты пиков на хроматограмме двух параллельных измерений, усредняют их значения. Рассчитывают концентрации веществ по формуле:

$$C = \frac{K \cdot \bar{h}_{1,2}}{V} \quad \text{мг/м}^3$$

где K — градуировочный коэффициент для шкалы электрометра, на который зафиксирован пик, мкг/см;

$\bar{h}_{1,2}$ — усредненное значение величины пика, см ($n=2$);

V — объем пробы воздуха, приведенный к нормальным условиям, дм³ (см. п. 2.1.6.).

2.3.7. Оформление результатов измерений.

Результаты измерений оформляют по форме, приведённой в табл. 2.4.

Таблица 2.4.

Результаты измерений

Вещество:	Дата отбора:	Проба:	Шкала электрометра, А	Градуировочный коэффициент, K_i	Высота пика, см	Среднее значение высоты пика, \bar{h}	Концентрация, С, мг/м ³
:	:	:	:	:	h_i	\bar{h}	
:	:	:	:	мкг	:	:	

2.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БУТИЛАКРИЛАТА И БУТИЛМЕТАКРИЛАТА

Методика предназначена для измерения массовых концентраций БА и БМА в атмосферном воздухе в диапазоне 0,002 - 0,1 мг/м³.

Определению не мешают: ацетон, метанол, изопропанол, бутанол, этилацетат, акрилонитрил, МА, ММА, АК, МАК, 2-ЭГА.

2.4.1. Погрешность измерения.

Суммарные погрешности измерения концентрации БА и БМА не превышают 20% и 23% соответственно

2.4.2. Метод измерения.

Определённые вещества улавливают на твёрдый сорбент силикохром С-80 с 5% ПМС-100 и анализируют на колонках с различными сорбентами.

2.4.3. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы.

2.4.3.1. Средства измерений см. п. 2.1.3.1.

2.4.3.2. Вспомогательные устройства см. П.2.3.3.2.

2.4.3.3. Материалы см. п.2.1.3.3.

2.4.3.4. Реактивы

Бутилакрилат, ч перегнанный	ТУ 6П-232-69
Бутилметакрилат, ч перегнанный	МРТУ 6-09-294I-66
Твёрдый носитель хроматон N-AW - НМД β , (0,20-0,25 мм), или хроматон N - "Сурев", или хроматон N-AW-ДМС β	
Твёрдый носитель силохром С-80, (0,25-0,55мм)	ТУ-6-09-17-48-79
Жидкая фаза ПМС-100, ч	МРТУ 6 № Ч
Жидкая фаза полифенилметил- силоксан ПМС-4	ГОСТ 15866-70
Жидкая фаза полиэтилен- гликольадипенат (ПЭГА), ч.д.а.	ТУ 6П65-67
Диэтиловый эфир	ГОСТ 6265-52
Хлороформ, х.ч.	ГОСТ 3160 - 51
Азот газообразный	ГОСТ 9293 - 74
Водород газообразный	ГОСТ 3022 - 77
Воздух от компрессора или сжатый в баллонах.	ГОСТ 11882 - 73

2.4.4. Подготовка к выполнению измерений

2.4.4.1. Подготовка испарителя хроматографа см. п. 2.1.4.1.

2.4.4.2. Подготовка хроматографических колонок.

Готовят две хроматографические насадки. Насадка № 1 - 10% ПМС
100+20% ПМС-4 на хроматоне (для колонки № 1); насадка № 2-20%

ПЭГА на хроматоне (для колонки № 2). Насадку № 1 готовят как описано в п. 2.3.4.2. Насадку № 2 готовят следующим образом: 2 г ПЭГА растворяют в подогретом хлороформе, раствором заливают 10 г хроматона, смесь встряхивают и оставляют до полного испарения хлороформа. Подготовленными насадками заполняют две 3-метровые колонки, устанавливают их в термостате хроматографа без подсоединения к детектору и кондиционируют в течение 8 час при постепенном повышении температуры от 50 до 150°C. После окончания кондиционирования колонки присоединяют к детекторам.

2.4.4.3. Подготовка сорбционных трубок см. п. 2.3.4.3.

2.4.4.4. Условия проведения хроматографического анализа.

Хроматографирование проб атмосферного воздуха на содержание концентраций БА и БМА проводят последовательно на 2-х колонках с разными насадками при следующих условиях:

Температура, °С	
испарителя	220
колонки № 1	80
колонки № 2	100
Скорости потоков, см ³ /мин	
азота	40
водорода	40
воздуха	400
Скорость протяжки	
диаграммной ленты, мм/ч	240

2.4.4.5. Установление градуировочной характеристики.

Для установления градуировочной характеристики создают ПГС БА и БМА с помощью капиллярных диффузионных ампульных дозаторов. Для создания ПГС БА используют дозатор с внутренним диаметром капилляра около 0,08 см и высотой 4,0 см, БМА - соответственно

около 0,4 см и 2,5 см. Дозаторы термостатируют при 20°C. Газ-носитель пропускают со скоростью 0,05–0,1 дм³/мин. На сорбционные трубки отбирают ПГС, содержащую различные количества измеряемых веществ в объеме до 3 дм³. Делают по 4 серии ПГС в диапазоне концентраций 0,002 – 0,1 мг/м³ и проводят по 5 – 6 параллельных измерений. На хроматографах измеряют высоты пиков и результаты заносят в табл. 2.3.

2.4.4.6. О т б о р п р о б.

Сорбционную трубку концом с отверстиями подсоединяют к аспиратору. Воздух аспирируют через трубку в течение 15 мин со скоростью 0,2 дм³/мин. После окончания отбора трубку заглушают с обоих концов и помещают в эксикатор. Отбирают не менее 4-х параллельных проб. Сорбционные трубки с уловленными примесями до анализа возможно сохранять в эксикаторе, но не более одной недели. Вместе с пробами хранят четыре контрольные сорбционные трубки, которые анализируют наряду с пробами.

2.4.5. Выполнение измерений.

При выполнении измерений концентраций БА и БМА в пробах атмосферного воздуха выполняют следующие операции:

Устанавливают рабочий режим прибора для колонки № I (см. п. 2.4.4.4.). Сорбционную трубку с пробой вставляют в испаритель хроматографа, соединенный с колонкой № I. Включают секундомер и диаграммную ленту. Проводят анализ второй параллельной пробы. Третью и четвертую параллельные пробы анализируют на колонке № 2 (см. п.2.4.4.4.).

2.4.6. Обработка результатов измерения (см. п. 2.3.6.).

2.4.7. Оформление результатов измерения (см. п.2.3.7.).

2.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2-ЭТИЛГЕКСИЛАКРИЛАТА

Методика предназначена для измерения массовых концентраций 2-ЭГА в атмосферном воздухе в диапазоне 0,001 - 0,1 мг/м³.

Определению не мешают: изопропиловый, бутиловый, 2-этилгексил-овый спирты, БА, БМА, МА, МАК, ароматические углеводороды.

2.5.1. Погрешность измерения.

Суммарная погрешность измерения концентраций 2-ЭГА не превышает 23,5%.

2.5.2. Метод измерения.

Определяемое вещество улавливают на твердый сорбент хе-засорб АW - НМДС с 5% SE-30 и анализируют на колонках с различными насадками.

2.5.3. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы.

2.5.3.1. Средства измерений см. П. 2.3.3.1.

2.5.3.2. Вспомогательный устройства см. п. 2.3.3.2.

2.5.3.3. М а т е р и а л ы см. п.2.1.3.3.

2.5.3.4. Р е а к т и в ы.

2-этилгексилакрилат, ч

перегнанный

ТУ 6-09-09-28-76

Твердый носитель

хроматон *N*- АW - НМДС

Э0,20 - 0,25 мм), или

хроматон *N*- "Шурец",

или хроматон *N*- АW - ДМС 2

Хроматографический сорбент

хезасорб АW - НМД

(0,25-0,30 мм) с 5% SE-30

Жидкая фаза ПМС - 100, ч	МРТУ 6 № _{еу}
Жидкая фаза ПЭГА, ч.д.а.	ТУ 6П-65-67
Хлороформ, х.ч.	ГОСТ 3160-51
Диэтиловый эфир	ГОСТ 6709 - 72
Азот газообразный	ГОСТ 9293 - 74
Водород газообразный	ГОСТ 3022 - 77
Воздух от компрессора или сжатый в баллонах	ГОСТ 11882 - 73

2.5.4. Подготовка к выполнению измерений.

2.5.4.1. Подготовка испарителя хроматографа см. п.2.1.4.1.

2.5.4.2. Подготовка хроматографических колонок.

Готовят две хроматографические насадки. Насадка № 1 - 10% ПМС-100 на хроматоне: 1 г фазы ПМС-100 растворяют в диэтиловом эфире и раствором заливают 10 г хроматона, смесь слегка встряхивают и испаряют эфир до сыпучего состояния насадки. Насадку № 2 - 20% ПЭГА на хроматоне готовят как описано в п.2.4.4.2.

Готовыми насадками заполняют две металлические трехметровые колонки, устанавливают их в термостате хроматографа без подсоединения к детектору и кондиционируют в течение 8 час при постепенном повышении температуры от 50 до 150°C. После окончания кондиционирования колонки подсоединяют к детектору.

2.5.4.3. Подготовка сорбционных трубок см. п.2.1.4.4.

2.5.4.4. Условия проведения хроматографического анализа.

Для проведения хроматографического анализа используют две колонки со следующими режимами работы:

Температура, °С	
испарителя	250
колонки № 1	130
колонки № 2	100

Скорость потоков, см ³ /мин	
азота	40
водорода	40
воздуха	400
Скорость протяжки	
диаграммной ленты, мм/ч	240

2.5.4.5. Установление градуировочной характеристики.

Для установления градуировочной характеристики создают ПГС 2-ЭГА с помощью диффузионного ампульного дозатора с внутренним диаметром капилляра 0,1 см и высотой 8 см. Дозатор термостатируют при 25°C. Скорость диффузионного потока 0,05 дм³/мин, скорость разбавляющего потока варьируют от 0,1 до 10 дм³/мин. Отбирают на сорбционные трубки по 2 л ПГС в диапазоне концентраций от 0,001 до 0,1 мг/м³. ПГС каждой концентрации создают не менее 4 раз и измеряют не менее 5 - 6 раз.

На хроматограмме измеряют высоты пиков и результаты заносят в табл. 2.3.

2.5.5.6. О т б о р п р о б

Сорбционную трубку концом с отверстиями подсоединяют к аспиратору и протягивают воздух в течение 20 мин со скоростью 0,1 дм³/мин. По окончании отбора трубку заглушают и помещают в эксикатор. Отбирают не менее 4-х параллельных проб.

Трубки с пробами, а также контрольные трубки возможно хранить в эксикаторе до анализа не более недели.

2.5.5. Выполнение измерений.

При выполнении измерений концентраций 2-ЭГА в пробах воздуха выполняют следующие операции:

Устанавливают рабочий режим для колонки № I (см. п. 2.5.4.4.).

Сорбционную трубку с пробой устанавливают в испарителе хроматографа, соединенном с колонкой № I.

Включают секундомер и диаграммную ленту.

Проводят измерение 2-ой параллельной пробы.

Устанавливают рабочий режим для колонки № 2 (см. п.2.5.4.4.) и анализируют 3-ю и 4-ю параллельные пробы.

2.5.6. Обработка результатов измерений см. п. 2.3.6.

2.5.7. Обработка результатов измерений см. 2.3.7.

3. КОНТРОЛЬ (МЕТ)АКРИЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ВОДЕ ВОДОЕМОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ.

3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКРИЛОВОЙ И МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТ.

Методика предназначена для измерения массовых концентраций АК и МАК в воде водоёмов хозяйственно-питьевого водопользования *в диапазоне* 0,02 - 1,0 мг/дм³.

Определению не мешают: эфиры акриловой и метакриловой кислот, содержащиеся в концентрациях до 20 мг/дм³, пропионовая и уксусная кислоты.

3.1.1. Погрешность измерения

Системная погрешность измерения АК не превышает 15%, МАК - 17%.

3.1.2. Метод измерения

Определение АК и МАК основано на газохроматографическом измерении концентраций кислот после предварительного концентрирования их в пробе методом упаривания.

3.1.3. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы.

3.1.3.1. Средства измерений

Хроматограф лабораторный газовый

с пламенно-ионизационным детектором
Весы аналитические ВЛА

ГОСТ 24104 - 80 Е

Меры массы

ГОСТ 7328 - 82 Е

Секундомер, класс 3

ГОСТ 5072 - 79 Е

Линейка измерительная

ГОСТ 427 - 56

Лупа измерительная

ГОСТ 8309 - 75

Цилиндры мерные 2-100-2	ГОСТ 1770 - 74
2-250-2	
Колбы мерные 2-100-2	ГОСТ 1770 - 74
2-500-2	
Пипетки 4 - I - 2	ГОСТ 20292 - 80
4 - 5 - 2	
Микрошприц МШ-10	ГОСТ 8043 - 74

3.1.3.2. Вспомогательные устройства

Редуктор кислородный	ТУ 26-65-235 - 76
Редуктор водородный	ТУ 26-05-463-76
Колонка хроматографическая стеклянная 300 х 0,3 см	ТУ 1550 - 33
Плитка электрическая	ГОСТ 306-58 и ГОСТ 303 - 56
Сосуд для муравьиной кислоты (рис. 1.1.).	
Аппарат для перегонки	
Пробирки вместимостью 2 см ³	ГОСТ 1770 - 74
Груша резиновая	ГОСТ 5496
Стаканы стеклянные термостойкие В-1-250 ТС	ГОСТ 25336 - 82
Чашки выпарительные вместимостью 25 см ³ и 100 см ³	ГОСТ 25336 82
Колбы конические вместимостью 100 см ³	ГОСТ 23932 - 79IE

3.1.3.3. М а т е р и а л ы

Стекловолокно
 Бумага индикаторная
 универсальная ТУ 6-09-1181-76

3.1.3.4. Р е а к т и в ы

Акриловая кислота, ч
 перегнанная ТУ 6-09-5886-69
 метакриловая кислота, ч
 перегнанная ТУ 6-02-17-68-64
 Муравьиная кислота ч.д.а. ГОСТ 5848 - 73
 Серная кислота, х.ч. ГОСТ 4204 - 77
 раствор (1 : 1) по объёму
 Вода дистиллированная ГОСТ 6709 - 72
 Гидроксид натрия, х.ч. ГОСТ 4328 - 66
 40% раствор
 Твёрдый носитель
 хроматон *N*-AW-НМД §
 /0,20-0,25мм/ или
 хроматон *N*- "§ реч"
 или хроматон *M*AW-ДМС §
 Жидкая фаза ПЭГА, ч.д.а. ТУ 6П-65-67
 Азот газообразный ГОСТ 9293 - 74
 Водород газообразный ГОСТ 3022 - 77
 Воздух от компрессора
 или сжатый в баллонах ГОСТ 11882 - 73

3.1.4. Подготовка к выполнению измерений

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы:

- подготовка газа-носителя;

- подготовка хроматографической колонки;
- приготовление 40%-го раствора гидроксида натрия;
- приготовление раствора серной кислоты (1 : 1);
- установление рабочего режима хроматографа;
- определение градуировочной характеристики.

3.1.4.1. Подготовка газа-носителя - см. п.2.1.4.2.

3.1.4.2. Приготовление 40%-го раствора гидроксида натрия.
40 г гидроксида натрия растворяют в 60 мл дистиллированной воды.

3.1.4.3. Приготовление раствора серной кислоты (1:1)

К 50 мл дистиллированной воды медленно вливают 50 мл концентрированной серной кислоты. Раствор готовят в термостойком стакане.

3.1.4.4. Подготовка хроматографической колонки - см.п.2.1.4.3.

3.1.4.5. Условия проведения хроматографического анализа - см. п. 2.1.4.5.

3.1.4.6. Установление градуировочной характеристики.

Для определения градуировочной характеристики используют растворы АК и МАК в дистиллированной воде. В мерных колбах вместимостью 50 см³ весовым методом готовят исходные растворы АК и МАК известной концентрации. Из исходных растворов в колбе на 50 см³ готовят градуировочный раствор с концентрацией АК и МАК по 20 мг/дм³. Из этого раствора в колбах вместимостью 0,5дм³ готовят градуировочные растворы в соответствии с табл. 3.1.

Таблица 3.1.

Растворы для установления градуировочной характеристики при определении АК и МАК

Номер градуировочного раствора	I	2	3	4	5
Объём раствора, см ³ (C=20 мг/дм ³)	0,40	1,2	2,5	120	250
Концентрация градуировочного раствора, мг/мл	0,02	0,05	0,1	5,0	10,0

Растворы кислот устойчивы в течение месяца. Готовят по 4 серии растворов. Каждую серию растворов разбивают на 3 подсерии. Хроматографируют каждую подсерию не менее 3 раз. Результаты измерений заносят в табл. 3.2.

Таблица 3.2.

Результаты определения градуировочной характеристики

Кислота	Концентрация раствора, мг/мл C	Шкала электрометра, А	Площадь пика, см ² S_i	Среднее значение площади пика, см ² \bar{S}	Градуировочный коэффициент, $K = \frac{C}{\bar{S}}$ мг/дм ³ · см ²
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:

3.1.5. Выполнение измерений

Объём пробы для концентрирования зависит от ожидаемых концентраций кислот: при содержании кислот в диапазоне 0,02 - 0,1 мг/дм³ упаривают 100 см³, свыше 0,1 мг/дм³ - 50 см³ пробы.

Концентрирование пробы проводят следующим образом:

В две конические колбы вместимостью 100 мл наливают 50-100 мл пробы, подщелачивают раствором гидроксида натрия до слабой щелочной среды, которую контролируют универсальной индикаторной бумагой. Затем упаривают небольшими порциями в фарфоровых чашках вмес-

тимостью 25 см³ на электрической плитке досуха. Охлажденный сухой остаток смывают 0,5 мл дистиллированной воды, подкисляют серной кислотой (1:1) до кислой среды, которую контролируют индикаторной бумагой. Концентрат переводят в пробирки.

Проверяют готовность аналитической колонки введением 5 мкл дистиллированной воды. При отсутствии в контрольном измерении пиков кислот приступают к хроматографированию пробы. В противном случае колонку промывают последовательным введением 5 мкл дистиллированной воды до полного отсутствия пиков кислот.

На хроматографический анализ отбирают микрошприцем 5 мкл концентрата и вводят в испаритель хроматографа.

Концентрации анализируют дважды.

Измеряют высоты пиков кислот по хроматограмме и усредняют их значения.

3.1.6. Обработка результатов измерений

Обработку результатов измерений концентраций АК и МАК в пробах воды выполняют следующим способом.

Измеряют высоты площади пиков по хроматограмме, полученные при анализе двух параллельных проб по два измерения каждой, и усредняют их значения.

Рассчитывают значения концентраций по формуле:

$$C = K_L \cdot \bar{S} \quad (I-4)$$

где K_L - градуировочный коэффициент для шкалы электрометра, на которой зафиксирован пик, мг/дм³;

\bar{S} (I-4) - усреднённое значение величин пика из 4-х измерений, см².

3.1.7. Оформление результатов измерений

Результаты измерений оформляют записью в журнале по форме, приведённой в табл. 3.3.

Табл. 3.3.

Результаты измерений

Дата:	Проба :	Кислота :	Объём :	Шкала :	K_L :	S_L :	\bar{S} :	C,
:	:	та :	пробы :	электро :	мг :	см ² :	см ² :	мг/дм ³
:	:	:	:	метра :	дм ³ см ² :	:	:	

3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТИЛАКРИЛАТА И МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА

Методика предназначена для измерения массовых концентраций МА и ММА в воде водоёмов хозяйственно-питьевого водопользования, в диапазоне 0,0008 - 0,5 мг/дм³.

Определению не мешают:

ацетон, этилацетат, акрилонитрил, метанол, хлороформ, БА, БМА, легкие предельные и непредельные углеводороды.

3.2.1. Погрешность измерения

Суммарная погрешность измерения МА не превышает 25%,
ММА - 22,3%.

3.2.2. Метод измерения

Метод определения МА и ММА в воде основан на газохроматографическом измерении концентраций веществ, извлеченных из пробы газовой экстракцией и уловленных на твёрдый сорбент.

3.2.3. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

При выполнении измерений применяются следующие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы.

3.2.3.1. Средства измерений

Хроматограф лабораторный газовый
серии "Цвет-100" с пламенно-ионизационным детектором

Весы аналитические ВЛА	ГОСТ 24104 - 80 Е
Меры массы	ГОСТ 7328 - 82 Е
Секундомер, класс 3	ГОСТ 5072 - 79 Е
Линейка измерительная	ГОСТ 427 - 56
Колбы мерные 2-50-2	ГОСТ 1770 - 74 Е
2-100-2	
Пипетки 4 - 5 - 2	ГОСТ 20292 - 74 Е
4 - 25 -2	

3.2.3.2. Вспомогательные устройства

Редуктор кислородный	ТУ 26-65-235-70
Редуктор водородный	ТУ 26-05-463-76

Вакуумный насос В II-46I	
Реометр стеклянный лабораторный типа РДС	ГОСТ 9932 - 6I
Колонки хроматографические металлические 300 x 0,3 см	ГОСТ 22056 - 76
Втулка для фиксации сорбционных трубок (рис. I.3)	
Сорбционные трубки (рис. I.3).	
Поглотительные приборы с шариковым распылителем (барботёр)	ТУ 25-III8 - 75
Штатив лабораторный (Ш)	
Аппарат для перегонки	ТУ 64-I-707-72
Груша резиновая	ГОСТ 5496
Стакан химический вместимостью 100 см ³	ГОСТ 25336 - 82
Чашка выпарительная вместимостью 100 см ³	ГОСТ 9147 - 80
Эксикатор	ГОСТ 637I - 73
Пенный расходомер	

3.2.3.3. М А Т Е Р И А Л Ы

Стекловолокно	
Шланги полихлорвиниловые, диаметром 3 - 4 мм или шланги из силиконовой резины, или шланги из медицинской резины	ТУ 64- 286 - 79 ТУ 38106152 - 77 ГОСТ 5496 - 78

3.2.3.4. Р е а к т и в ы

Метилакрилат, ч перегнаный	ТУ 8П-145 - 68
Метилметакрилат, хром, чистый	ТУ ИРЕА 29 -66
Твёрдый носитель хроматон N- AW - НМДС (0,20-0,25 мм) или хроматон N- "Заpec" или хроматон N- AW - ДМС	
Твёрдый носитель силохром С-80 (0,25 - 0,50 мм)	ТУ 6-09-17-48-74
Жидкая фаза ДДФ, ч	МРТУ 6-09-950-63
Жидкая фаза ПМС-100, ч	МРТУ 6№У

Жидкая фаза ПМС-4, ч	ГОСТ 15866 - 70
Диэтиловый эфир, х.ч.	ГОСТ 6265 - 52
Вода дистиллированная	ГОСТ 6709 - 72
Азот газообразный	ГОСТ 9293 - 74
Водород газообразный	ГОСТ 3022 - 77
Воздух от компрессора или сжатый в баллонах	ГОСТ 11882 - 73

3.2.4. Подготовка к выполнению измерений

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы: подготовка испарителя хроматографа, подготовка хроматографических колонок, подготовка сорбционных трубок, подготовка установки для газовой экстракции, установление рабочего режима хроматографа, определение градуировочной характеристики.

3.2.4.1. Подготовка испарителя хроматографа - см. п. 2.1.4.1.

3.2.4.2. Подготовка хроматографических колонок - см. 2.3.4.2.

3.2.4.3. Подготовка сорбционных трубок - см. п. 2.3.4.3.

3.2.4.4. Подготовка установки для газовой экстракции

К импачнику газа-экстрагента с помощью шланга подсоединяют реометр. Пенным расходомером проверяют калибровку реометра. Требуемая скорость потока газа-экстрагента $100 \text{ см}^3/\text{мин}$. Схема установки для газовой экстракции приведена на рис. 1.4.

3.2.4.5. Условия проведения газохроматографического анализа см. п. 2.3.4.4.

3.2.4.6. Определение градуировочной характеристики

Для определения градуировочной характеристики МА и ММА в мерных колбах вместимостью 50 см^3 готовят исходные растворы МА и ММА в дистиллированной воде известной концентрации. Из исходных растворов в колбе вместимостью 200 см^3 готовят градуировочный раствор МА и ММА с концентрациями $20 \text{ мг}/\text{дм}^3$. Из этого раствора в колбах вместимостью 100 см^3 последовательным разбавлением готовят градуировочные растворы в соответствии с табл. 3.4.

Таблица 3.4.

Растворы для установления градуировочной характеристики
М А и М М А

Номер градуировочного раствора	: I	: 2	: 3	: 4	: 5
Объём раствора, см ³ (C=20 мг/дм ³)	: -	: -	: -	: -	: 2,5
Объём раствора, см ³ (C=0,5 мг/дм ³)	: -	: -	: I	: IO	: -
Объём раствора, см ³ (C=0,05 мг/дм ³)	: I,6	: 2,0	: -	: -	: -
Концентрация градуировочного раствора, мг/дм ³	: 0,0008	: 0,001	: 0,005	: 0,05	: 0,5

Готовят по 5 серий растворов каждой концентрации. Раствор с концентрацией 20 мг/дм³ устойчив в течение 3-х недель. Растворы с меньшими концентрациями готовят непосредственно перед проведением измерений. Делают по 5 параллельных измерений каждой концентрации в каждой серии. Как описано в п.3.2.5. На хроматограммах измеряют высоты пиков и результаты измерений заносят в табл. 3.5.

Таблица 3.5.

Результаты определения градуировочной характеристики

Вещество	Концентрация, С	Шкала электрометра, А	Высота пика, h_i , см	Среднее значение высоты, h , см	Градуировочный коэффициент, $K = \frac{C}{h}$, мг/дм ³ , см
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:

3.2.5. Выполнение измерений

При выполнении измерений концентраций МА и ММА в пробах воды проводят следующие операции.

3.2.5.1. Выводят прибор на рабочий режим по п.2.3.4.4.

Проверяют частоту сорбционных трубок на шкале электрометра 20 · 10⁻¹² А.

3.2.5.2. Проверяют чистоту барботеров

Анализируют контрольные пробы дистиллированной воды из барботеров, предназначенных для работы. Контрольная проба не должна давать пиков со временем удерживания измеряемых веществ. В противном случае требуется дополнительная очистка барботеров. Барботеры моют хромовой смесью, затем промывают дистиллированной водой и пропаривают в течение 20 мин.

3.2.5.3. Проводят газовую экстракцию пробы следующим образом.

В проглотительный прибор заливают 5 мл пробы, подсоединяют его к реометру и укрепляют на штативе. К выходному концу поглотительного прибора подсоединяют сорбционную трубку конусным концом. Включают поток газа-экстрагента и доводят его до отметки реометра $100 \text{ см}^3/\text{мин}$. Включают секундомер и проводят газовую экстракцию в течение 10 мин. По истечении времени экстракции выключают поток газа-экстрагента и отсоединяют сорбционную трубку. Из барботера выливают проэкстрагированную пробу, заполняют его вновь анализируемой пробой и повторяют экстракцию. Всего анализируемую воду экстрагируют не менее 4-х раз, получая таким образом 4-е параллельные пробы.

Газовую экстракцию проводят в день отбора пробы. Сорбционные трубки с экстрагированными примесями до анализа сохраняют в эксикаторе. Трубки с пробами можно сохранять не более 3-х дней.

3.2.5.4. Для проведения хроматографического анализа сорбционную трубку с экстрагированными примесями устанавливают в испарителе хроматографа, соединенным с колонкой № I (см. п. 2.3.4.4.). Включают секундомер и диаграммную ленту. Также анализируют вторую параллельную пробу.

Анализ 3-ей и 4-ой параллельных проб проводят на колонке № 2 (см. п. 2.3.4.4.).

3.2.6. Обработка результатов измерений

Обработку результатов измерений концентраций МА и ММА в пробах воды выполняют следующим способом:
на хроматограммах, полученных при хроматографировании параллельных проб на различных колонках, идентифицируют пики МА и ММА, а для обработки выбирают ту из хроматограмм, где наблюдается наибольшее деление определяемых веществ от сопутствующих примесей.

Измеряют высоты пиков на хромато двух параллельных изме- рений и усредняют их значения.

Рассчитывают концентрации веществ по формуле:

$$C = K \cdot h_{1,2} \quad \text{мг/дм}^3$$

где K — градуировочный коэффициент для шкалы электрометра, на которой зафиксирован пик, $\text{мг/дм}^3 \cdot \text{см}^2$

$\bar{h}_{1,2}$ — усреднённое значение величины пика, см ($n=2$).

3.2.7. Оформление результатов измерений

Результаты измерений оформляют записью в журнале по форме, приведённой в табл. 3.6.

Таблица 3.6.

Результаты измерений

Веще- ство	Дата отбора	Проба	Шкала электро- метра	Градуиро- вочный коэффи- циент	Высота пика, h_i см	Среднее значение высота пика, \bar{h} см	Концент- рация, С
:	:	:	А	К	:	:	:
:	:	:	:	мг	:	:	мг/дм ³
:	:	:	:	дм ³ см	:	:	:

3.3.3.4. Реактивы

Бутилакрилат, ч, перегнанный	ТУ БП - 232 - 69
Бутилметакрилат, ч, перегнанный	МРТУ 3-09-294Г - 66
Твёрдый носитель хроматон <i>N</i> -AW-НМДЗ (0,20 - 0,25 мм) или хроматон <i>N</i> - "9-рец" или хроматон <i>N</i> - AW - ДМСЗ	
Твёрдый носитель силохром С-80 (0,25-0,50 мл)	ТУ 6-09-17-48-74
Жидкая фаза ПМС-100, ч	МРТУ 6 №У
Жидкая фаза ПМС -Ч, ч	ГОСТ 15866 - 70
Жидкая фаза ПЭГА, ч.д.а.	ТУ 6П-65-67
Хлороформ, х.ч.	ГОСТ 3160 - 5Г
Диэтиловый эфир	ГОСТ 6265 - 52
Вода дистиллированная	ГОСТ 6709 - 72
Азот газообразный	ГОСТ 9293 - 74
Водород газообразный	ГОСТ 3022 - 77
Воздух от компрессора или сжатый в баллонах	ГОСТ 11882 - 73

3.3.4. Подготовка к выполнению измерений

3.3.4.1. Подготовка испарителя хроматографа-см.п.2.1.4.1.

3.3.4.2. Подготовка хроматографических колонок -
см. п. 2.3.4.2.

3.3.4.3. Подготовка сорбционных трубок -см. п. 2.3.4.3.

3.3.4.4. Подготовка установки для газовой экстракции -
см. п.3.2.4.4.3.3.4.5. Условия проведения газо-хроматографического
анализа - см. п. 2.3.4.4.

3.3.4.6. Определение градуировочной характеристики.

Для определения градуировочной характеристики БА и БАД в мерных колбах вместимостью 50 см³ готовят исходные растворы

БА и БМА в дистиллированной воде известной концентрации. Из исходных растворов в колбе вместимостью 100 см³ готовят градуировочный раствор с концентрациями БА и БМА по 50 мг/дм³. Из этого раствора в колбах по 50 см³ последовательным разбавлением готовят градуировочные растворы в соответствии с табл. 3.7.

Таблица 3.7.

Растворы для установления градуировочной характеристики при определении БА и БМА

Номер градуировочного раствора	1	2	3	4	5
Объём раствора см ³ (C=5 мг/дм ³)	5	0,5	-	-	-
Объём раствора, см ³ (C=0,5 мг/дм ³)	-	-	0,5	0,2	0,1
Концентрация градуировочного раствора мг/дм ³	0,5	0,05	0,005	0,002	0,001

Разбавленные градуировочные растворы готовят непосредственно перед проведением измерений. Готовят по 5 серий растворов каждой концентрации. Раствор с концентрацией 5 мг/л не изменяется в течение 20 суток.

Для определения градуировочной характеристики в условиях анализа измеряют каждый градуировочный раствор, делая по 5 параллельных измерений. На хроматограммах измеряют высоты пиков и результаты измерений заносят в табл. 3.5.

3.3.5. Выполнение измерений

При выполнении измерений концентраций БА и БМА в пробе воды выполняют следующие операции:

3.3.5.1. Выводят прибор на рабочий режим по п. 2.4.4.4.

Проверяют чистоту сорбционных трубок на шкале электрометра $20 \cdot 10^{-12}$ А.

3.3.5.2. Проверяют чистоту барботёра - см. п. 3.2.5.2.

3.3.5.3. Проводят газовую экстракцию следующим способом: в поглотительный прибор заливают 5 см³ пробы, подсоединяют его к реометру и укрепляют на штативе. В выходному концу поглотительного прибора подсоединяют сорбционную трубку конусным концом, включают поток газа-экстрагента и доводят его до отметки реометра 150 см³/мин. Включают секундомер и проводят газовую экстракцию в течение 20 мин. По истечении времени экстракции выключают поток газа-экстрагента и отсоединяют сорбционную трубку.

Из барботёра выливают проэкстрагированную пробу, заполняют его вновь анализируемой пробой и проводят экстракцию. Всего анализируемую воду экстрагируют не менее 4-х раз, получая таким образом 4-е параллельные пробы.

Газовую экстракцию проводят в день отбора пробы. Сорбционные трубки с уловленными примесями до анализа сохраняют заглушенными в эксикаторе. Трубки с пробами можно хранить не более 3-х суток.

3.3.5.4. Для проведения хроматографического анализа трубку с экстрагированными примесями устанавливают в испарителе хроматографа, соединенным с колонкой № 1 (см. п. 2.4.4.4.). Включают секундомер и диаграммную ленту. Затем анализируют вторую параллельную пробу. Анализ третьей и четвертой параллельных проб проводят на колонке № 2 (см. п. 2.4.4.4.).

3.3.6. Обработка результатов измерений - см. п. 3.2.6.

3.3.7. Оформление результатов измерений - см. п. 3.2.7.

3.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2 - ЭТИЛГЕКСИЛАКРИЛАТА

Методика предназначена для измерения массовых концентраций 2-ЭГА в воде водоёмов хозяйственно-питьевого водопользования в диапазоне 0,0005 - 0,5 мг/дм³.

Определению не мешают: изопропиловый, бутиловый, 2 - этилгексильный спирты, БА, БМА, ароматические углеводороды, АК и МАК.

3.4.1. Погрешность измерения

Суммарная погрешность измерения концентраций 2-ЭГА не превышает 23,5%.

3.4.2. Метод измерения

Определение 2-ЭГА основано на газохроматографическом измерении концентраций вещества, извлеченного и пробы газовой экстракцией и уловленного на твёрдый сорбент хезасорб АВ-ИМДС с 5% SE-30.

3.4.3. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

3.4.3.1. Средства измерений

Хроматограф лабораторный газовый серии "Цвет-100" с пламенно-ионизационным детектором

Весы аналитические ВЛА

Меры массы

Секундомер, класс 3

Линейка измерительная

Колбы мерные 2 - 50 - 2

2 - 100 - 2

2 - 500 - 2

Пипетки 4 - 5 - 2

4 - 1 - 2

ГОСТ 24104 - 80 Е

ГОСТ 7328 - 82 Е

ГОСТ 5070 - 79 Е

ГОСТ 427 - 56

ГОСТ 1770 - 74 Е

ГОСТ 20292 - 74 Е

3.4.3.2. Вспомогательные устройства - см. п. 3.2.3.2.

3.4.3.3. Материалы - см. п. 3.2.3.3.

3.4.3.4. Реактивы

2-этилгексилакрилат	ТУ 6-09-09-28-76
Твердый носитель	
Хроматон N - AW - НМДС	
(0,20-0,25 мм),	
или хроматон N - "Зареч",	
или хроматон N - AW ДМС	
Хроматографический сорбент	
хезасорб AW - НМДС	
(0,25 - 0,30мм) с 5% Е-30	
Жидкая фаза ПМС-100, ч	МРТУ 6№У
Жидкая фаза ПЭГА, х.ч.	ТУ 6П - 65 - 67
Хлороформ, х.ч.	ГОСТ 3160 - 51
Диэтиловый эфир, х.ч.	ГОСТ 6265 - 52
Дистиллированная вода	ГОСТ 6704 - 72
Азот газообразный	ГОСТ 9293 - 74
Водород газообразный	ГОСТ 3022 - 77
Воздух от компрессора	
или сжатый в баллонах	ГОСТ 11682 - 73

3.4.4. Подготовка к выполнению измерений.

3.4.4.1. Подготовка испарителя хроматографа - см. п. 2.1.4.1.

3.4.4.2. Подготовка хроматографических колонок-см.п. 2.5.4.2.

3.4.4.3. Подготовка сорбционных трубок - см. п. 2.1.4.3.

3.4.4.4. Подготовка установки для газовой экстракции-см.п.3.2.4.4

3.4.4.5. Условия проведения газохроматографического анализа-
см. п. 2.5.4.4.

3.4.4.6. Определение градуировочной характеристики

Для определения градуировочной характеристики 2-ЭГА в мерной колбе вместимостью 50 см³ взвешивают 1 каплю 2-ЭГА в дистиллированной воде. Раствор переводят в мерную колбу вместимостью 500 см³ и доводят до метки дистиллированной водой. Из исходного раствора в колбе вместимостью 50 см³ готовят градуировочный раствор с концентрацией 5 мг/дм³. Из этого раствора последовательным разбавлением готовят градуировочные растворы в соответствии с табл. 3.8.

Таблица 3.8.

Раствор для установления градуировочной характеристики при определении 2-ЭГА

Номер градуировочного раствора	1	2	3	4	5
Объём раствора, см ³ (C=5 мг/дм ³)	5	0,5	-	-	-
Объём раствора, см ³ (C=0,5 мг/дм ³)	-	-	0,5	0,1	0,05
Концентрация градуировочного раствора, мг/дм ³	0,5	0,05	0,005	0,001	0,0005

Разбавленные градуировочные растворы готовят непосредственно перед проведением определения. Готовят по 5-6 серий растворов каждой концентрации. Исходный раствор с концентрацией более 5 мг/л не изменяется в течение недели.

Для определения градуировочной характеристики в условиях анализа измеряют каждый градуировочный раствор, делая по 5 параллельных измерений. На хроматограмме измеряют высоты пиков и результаты измерений заносят в табл. 3.5.

3.4.5. Выполнение измерений

При выполнении измерений концентраций 2-ЭГА в пробе воды выполняют следующие операции:

3.4.5.1. Выводят прибор на рабочий режим - см. п. 2.5.4.4.

Проверяют чистоту сорбционных трубок по шкале электрометра $20 \cdot 10^{-12} \text{А}$.

3.4.5.2. Проводят газовую экстракцию.

В барботёр заливают 5 см^3 пробы, подсоединяют его к реометру и укрепляют на штативе. К выходному концу барботера подсоединяют сорбционную трубку конусным концом. Включают поток газа-экстрагента и доводят его до отметки $100 \text{ см}^3/\text{мин}$. Включают секундомер и проводят газовую экстракцию в течение 20 мин. По истечении времени экстракции выключают поток газа-экстрагента и отсоединяют сорбционную трубку. Из барботёра выливают проэкстрагированную пробу, заполняют его вновь анализируемой водой и проводят экстракцию.

Всего экстрагируют четыре параллельные пробы анализируемой воды.

Газовую экстракцию проводят в день отбора пробы. Сорбционные трубки с экстрагированными примесями до анализа сохраняют заглушенными в эксикаторе. Трубки с пробами можно хранить не более недели.

3.4.5.3. Для проведения хроматографического анализа сорбционную трубку с экстрагированными примесями устанавливают в испарителе хроматографа, соединенном с колонкой № 1 (см. п. 2.5.4.4.).

Включают секундомер и диаграммную ленту. Также анализируют вторую параллельную пробу. Анализ третьей и четвертой параллельных проб проводят на колонке № 2 (см. п. 2.5.4.4.).

3.4.6. Обработка результатов измерений - см. п. 3.2.6.

3.4.7. Оформление результатов измерений - см. п. 3.2.7.

4. КОНТРОЛЬ (МЕТ)АКРИЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ПОЧВЕ

4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКРИЛОВОЙ И МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТ

Методика предназначена для измерения массовых концентраций АК и МАК в пробах почвы в диапазоне 0,04 – 2,0 мг/кг.

Определению не мешают: эфиры (мет)акриловых кислот, пропионовая и уксусная кислоты, ароматические углеводороды.

4.1.1. Погрешность измерения

Суммарная погрешность измерения АК не превышает 23%, МАК – 21%.

4.1.2. Метод измерения

Определение АК и МАК в пробах почвы основано на газохроматографическом измерении концентраций кислот, извлеченных из пробы растворителями.

4.1.3. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

4.1.3.1. Средства измерений

Хроматограф лабораторный газовый с пламенно-ионизационным детектором	
Весы аналитические ВЛА	ГОСТ 24104 - 80 Е
Меры массы	ГОСТ 7328 - 82 Е
Секундомер, класс 3	ГОСТ 5072 - 79 Е
Линейка измерительная	ГОСТ 427 - 56
Лупа измерительная	ГОСТ 8309 - 75
Цилиндры мерные 2-100-2	ГОСТ 1770 - 74
Колбы мерные 2- 50 - 2	ГОСТ 1770 - 74
2-200 - 2	
Пипетки 4 - 10 - 2	
4 - 50 - 2	ГОСТ 20292 - 80
Микрошприц МШ-10	ГОСТ 8043 - 74

4.1.3.2. Вспомогательные устройства

Редуктор кислородный	ТУ 26-65-235-70
Редуктор водородный	ТУ 26-05-463-76
Колонка хроматографическая стеклянная 30 x 0,3 см	ТУ 1550 - 33
Плитка электрическая	ГОСТ 306 - 58
	или ГОСТ 303 - 56
Аппарат для встряхивания	ТУ 64-I-245I - 78
Сосуд для муравьиной кислоты (см. рис. I.I.)	
Пробирки вместимостью 2 см ³	23932 - 79
Аппарат для перегонки	
Груша резиновая	ГОСТ 5496
Стакан химический	ГОСТ 25336 - 82
Колбы конические вместимостью 100 см ³	ГОСТ 1770 - 74
Воронки В-25-50-ХС	ГОСТ 25336 - 82
Чашки выпарительные 4ИВА1 - 25	ГОСТ 10973 - 75
Сита	

4.1.3.3. М а т е р и а л ы

Стекловолокно	
Бумага фильтровальная	
Бумага индикаторная универсальная	ТУ 6-09-II8I - 76

4.1.3.4. Р е а к т и в ы

Акриловая кислота, ч перегнанная	ТУ 6-09-5886 - 69
Метакриловая кислота, перегнанная	ТУ 6-02-1768 - 64
Серная кислота, х.ч. раствор (1:1) по объёму	ГОСТ 4204 - 77
Муравьиная кислота, ч.д.а.	ГОСТ 5848 - 73
Вода дистиллированная	ГОСТ 6709 - 72
Гидроксид натрия, х.ч.	ГОСТ 4328 - 66
40%-й раствор	

Ацетон, х.ч.	ТУ 6-09-1707 - 77
Этанол, ректификат	ГОСТ 5962 - 67
Хроматон N- AW - НМД ³ (0,20 - 0,25мм), или хроматон N- "Сарец", или хроматон N-AV - ДМС ³	
Жидкая фаза ПЭГА, ч.д.а	ТУ 6П - 65 - 67
Азот газообразный	ГОСТ 9293 - 74
Водород газообразный	ГОСТ 3022 - 77
Воздух от компрессора или сжатый в баллонах	ГОСТ 11882 - 73

4.1.4. Подготовка к выполнению измерений

4.1.4.1. Подготовка газа-носителя - см. п.2.1.4.2.

4.1.4.2. Приготовление 40%-го раствора гидроксида натрия - см. п. 3.1.4.2.

4.1.4.3. Приготовление раствора серной кислоты (1:1)-
см. п. 3.1.4.3.

4.1.4.4. Приготовление экстрагента

Готовят экстракционную смесь из ацетона, этанола и дистиллированной воды в объёмном соотношении соответственно 1:1:3.

4.1.4.5. Приготовление контрольной почвы

Почву высушивают в тени на листах бумаги до воздушного-сухого состояния. Затем растирают в фарфоровой ступке и просеивают через сито с отверстиями 1 мм. Подготовленную почву хранят в стеклянных ёмкостях с закрывающимися герметично крышками.

4.1.4.6. Подготовка хроматографической колонки-см.
п. 2.1.4.3.

4.1.4.7. Условия проведения хроматографического анализа-
см. п. 2.1.4.5.

4.1.4.6, Установление градуировочной характеристики

Для определения градуировочной характеристики используют искусственные образцы контрольной почвы с растворами АК и МАК заданных концентраций.

В мерных колбах вместимостью 50 см³ весовым методом готовят исходные растворы № 1 в ацетоне АК и МАК известной концентрации. Из растворов № 1 в колбе вместимостью 200 см³ готовят раствор № 2 с концентрациями АК и МАК 2,0 мг/дм³.

Из раствора № 2 в колбах вместимостью 200 см³ готовят растворы кислот в ацетоне в соответствии с табл. 4.1.

Таблица 4.1.

Рабочие растворы и образцы почвы для установления градуировочной характеристики

Номер рабочего раствора :	1	2	3	4	5	6
и градуировочного образца:	:	:	:	:	:	:
почвы	:	:	:	:	:	:
Объём исходного раствора :	:	:	:	:	:	:
№ 2, (см ³) (C = 2 мг/дм ³) :	4	10	20	50	100	-
Концентрация рабочего раствора, мг/дм ³ , кон-	:	:	:	:	:	:
центрация градуировоч-	:	:	:	:	:	:
ного образца почвы,	:	:	:	:	:	:
мг/кг	0,04	0,1	0,2	0,5	1,0	2,0

Готовят по 4 серии рабочих растворов каждой концентрации.

Растворы кислот в ацетоне устойчивы.

Для приготовления градуировочных образцов по 20 г контрольной почвы заливают 20 см³ соответствующих рабочих растворов.

Измерения проводят по описанию в п. 4.1.5. Проводят по 5 параллельных измерений каждого образца в каждой серии. На хроматограммах измеряют площади пиков АК и МАК и результаты измерений заносят в табл. 4.2.

Результаты определения градуировочной характеристики

Кислота	Концентрация образца C мг/кг	Шкала электрометра, А	Площадь пика, S_i см ²	Среднее значение площади пика, S см ²	Градуировочный коэффициент, $K = \frac{C}{S}$ мг/кг · см ²
---------	--------------------------------------	--------------------------	---	--	---

4.1.4.9. Подготовка аналитической пробы - см. п. 1.5.3.2.

4.1.5. Выполнение измерений

При выполнении измерений концентрации АК и МАК в пробах почвы выполняют следующие операции.

4.1.5.1. Взвешивают по 20 г четыре порции аналитической пробы. Две порции оставляют для определения коэффициента влажности $K_{вл}$. Оставшиеся две порции пробы помещают в конические колбы, приливают по 50 мл экстракционной смеси и устанавливают на 0,5 ч на аппарат для встряхивания. Пробы отстаивают в течение 0,5 ч., затем отфильтровывают. Фильтрат подщелачивают 40%-м раствором гидроксида натрия, контролируя среду с помощью универсальной индикаторной бумаги, затем упаривают досуха. Сухой остаток смывают 0,5 см³ дистиллированной воды и подкисляют раствором серной кислоты (1:1) до pH 2-4. Хроматографируют 5 мкл пробы. Проводят не менее 2-х параллельных измерений.

4.1.5.2. Измеряют влажность аналитической пробы. Две навески почвы помещают в химические стаканы и доводят до ~~постоянной~~ массы при температуре нагрева $105 \pm 2^\circ\text{C}$ в течение 8 ч.

4.1.6. Обработка результатов измерений

Обработку результатов измерений концентраций АК и МАК в пробах почвы выполняют следующим способом.

На хроматограмме идентифицируют пики кислот, измеряют их площадь и усредняют значения площади двух параллельных измерений из двух проб.

Рассчитывают концентрацию кислот по формуле:

$$C = K \cdot \bar{S}_{1-4} \cdot K_{вл}. \quad (\text{мг/кг})$$

где K - градуировочный коэффициент для шкалы электрометра, на которой измерен пик, $\text{мг/кг} \cdot \text{см}^2$;

\bar{S}_{I-4} - усреднённое значение площади пика, см^2 ($n=4$);

$K_{\text{вл.}}$ - коэффициент влажности

$$K_{\text{вл.}} = 100 / (100 - \omega)$$

где ω - влажность почвы, %

$$\omega = (M_1 - M_0) 100 / (M_0 - m)$$

где M_1 - масса влажной почвы со стаканом, г;

M_0 - масса высушенной почвы со стаканом, г ;

m - масса стакана, г.

4.1.7. Оформление результатов измерений

Результаты измерений оформляют записью в журнале по форме, приведённой в табл. 4.3.

Таблица 4.3.

Результаты измерений

Кисло- та	Дата	Проба	Шкала электро- метра А	Градуиро- вочный коэффи- циент, К мг/кг · см ²	Площадь пика, S_i см ²	Среднее значение площади пика, \bar{S} , см ²	Концентра- ция, С, мг/кг
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:

4.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТИЛАКРИЛАТА И МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА

Методика предназначена для измерения массовых концентраций МА и ММА в пробах почвы в диапазоне 0,002 - 0,1 мг/кг.

Определению не мешают спирты $C_1 - C_4$, акрилонитрил, ацетонитрил, этилацетат, ацетан, хлороформ, бензол, стирол, БА, БМА.

4.2.1. Погрешность измерения

Суммарная погрешность измерения МА не превышает 2%, ММА - 21%.

4.2.2. Метод измерения

Определение МА и ММА в пробах почвы основано на измерении концентраций веществ, извлеченных газовой экстракцией из разбавленной водой почвы и уловленных на твердый сорбент.

4.2.3. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

При выполнении измерений применяются следующие средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы.

4.2.3.1. Средства измерений

Хроматограф лабораторный газовый
серии "Цвет-100" с пламенно-ионизационным детектором

Весы аналитические ВЛА	ГОСТ 24104 - 80 Е
Меры массы	ГОСТ 7328 - 82 Е
Секундомер, класс 3	ГОСТ 5072 - 79 Е
Линейка измерительная	ГОСТ 427 - 56
Колбы мерные 2-50 - 2	
2-200- 2	ГОСТ 1770 - 74 Е
Пипетки 4 - 1 - 2	
4 - 5 - 2	
4 -25 - 2	ГОСТ 20292 - 74 Е

4.2.3.2. Вспомогательные устройства

Редуктор кислородный	ТУ 26-65-235-70
Редуктор водородный	ТУ 26-05-463-76
Реометр стеклянный лабораторный типа РДС	ГОСТ 9932 - 61

Колонки хроматографические металлические 300 x 0,3 см	ГОСТ 22056 - 76
Втулка для фиксации сорбционных трубок (рис. 1.2.)	
Сорбционные трубки (рис. 1.2.).	
Барботёры вместимостью 125 см ³ .	
Сита с величиной отверстия 1 мм	
Груша резиновая	ГОСТ 5496
Стакан химический вместимостью 100 см ³	ГОСТ 25336 - 82
Чашка выпарительная вместимостью 100 см ³	ГОСТ 9147 - 80
Эксикатор	ГОСТ 6371 - 73
Пенный расходомер	
Ступка фарфоровая	
4.2.3.3. Материалы - см. п. 4.1.3.3.	
4.2.3.4. Реактивы	
Метилакрилат, ч перегнаный	ТУ 8П - 145 - 68
Метилметакрилат, хром. чистый	ТУ ИРЕА 29 - 66
Твёрдый носитель хроматон М-АВ - НМД δ (0,20 - 0,25 мм), или хроматон М- "Ширец" или хроматон М- АВ - ДМС δ	
Твёрдый носитель силохром С-80 (0,25-0,50мм)	ТУ 6-09-17-40-74
Жидкая фаза ДДФ, τ	МРТУ 6-09-958 - 63

Лидкая фаза ПМС-100, г	МРТУ 6 №У
Лидкая фаза ПМС-4, ч	ГОСТ 15866 - 70
Диэтиловый эфир, х.ч.	ГОСТ 6265 - 52
Вода дистиллированная	ГОСТ 6704 - 72
Азот газообразный	ГОСТ 9293 - 74
Водород газообразный	ГОСТ 3022 - 77
Воздух вт компрессора или сжатый в баллонах	ГОСТ 11882 - 73

4.2.4. Подготовка к выполнению измерений

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы.

4.2.4.1. Подготовка испарителя хроматографа -
см. п. 2.1.4.1.

4.2.4.2. Подготовка хроматографических колонок -
см. п. 2.3.4.2.

4.2.4.3. Подготовка сорбционных трубок - см. п. 2.3.4.3.

4.2.4.4. Подготовка установки для газовой экстракции

К источнику газа-экстрагента с помощью шланга подсоединяют откалиброванный реометр. Схема установки для газовой экстракции приведена на рис. 1.4.

4.2.4.5. Подготовка контрольной почвы - см. п. 4.1.4.5.

4.2.4.6. Условия проведения хроматографического анализа - см. п. 2.3.4.4.

4.2.4.7. Определение градуировочной характеристики

Для определения градуировочной характеристики МА и ММА готовят градуировочные образцы почвы с заданными концентрациями. Для этого в мерных колбах вместимостью 50 см³ готовят исходные растворы МА и ММА известной концентрации в дистиллированной воде - растворы № 1. Из исходных растворов № 1 в мерной колбе вместимостью 200 см³ готовят исходный раствор № 2 с концентрациями МА и ММА 1 мг/дм³. Из этого раствора последовательным разбавлением в колбах вместимостью 200 см³ готовят рабочие растворы в соответствии с табл. 4.4.

Таблица 4.4.

Рабочие растворы и образцы почвы для установления градуировочной характеристики

Номер рабочего раствора и образца почвы	: I	: 2	: 3	: 4	: 5	: 6
Объём исходного раствора № 2 /C=	: 0,4	: 1,0	: 2,0	: 4,0	: 10,0	: 20,0
= I мг/дм ³ , см ³	:	:	:	:	:	:
Концентрация рабочего раствора, мг/дм ³ и	:	:	:	:	:	:
концентрация градуировочного образца почвы, мг/кг	: 0,002	: 0,005	: 0,01	: 0,02	: 0,05	: 0,10
	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:

Для приготовления градуировочных образцов почвы по 30 г контрольной почвы заливают 30 см³ соответствующих растворов. Готовят по 4 серии рабочих растворов и градуировочных образцов почвы. Как рабочие растворы, так и градуировочные образцы почвы готовят непосредственно перед проведением измерений. Измерения проводят как описано далее в п. 4.2.5. Проводят по 5 параллельных измерений каждой серии градуировочных образцов. На хроматограммах измеряют высоты пиков МА и ММА и результаты измерений заносят в табл. 4.5.

Таблица 4.5.

Результаты определения градуировочной характеристики

Вещество	: Концентрация,	: Шкала	: Высота	: Среднее	: Градуировоч-
	: С	: электро-	: пика,	: значение:	: ный коэффи-
	: мг/кг	: метра,	: h_i	: высоты,	: циент,
	:	: А	: см	: пика,	: $K=C/h$
	:	:	:	: h	: h
	:	:	:	: см	: мг/кг · см

4.2.5. Выполнение измерений

При выполнении измерений концентраций МА и ММА в пробах почвы проводят следующие операции:

4.2.5.1. Взвешивают по 30 г шесть порций аналитической пробы почвы. Две порции пробы оставляют для определения коэффициента влажности $K_{вл}$. Из оставшихся четырех порций пробы проводят поочередно газовую экстракцию следующим образом. В барботёр помещают 30 г пробы, заливают её 30 см³ дистиллированной воды, смесь встряхивают для перемешивания почвы с водой. К входному концу барботера подсоединяют источник газа-экстрагента, к выходному - сорбционную трубку. Включают поток газа-экстрагента, доводят его до отметки реометра 100 см³/мин. Включают секундомер и проводят газовую экстракцию в течение 10 мин. По истечении времени экстракции выключают поток газа-экстрагента и отсоединяют сорбционную трубку. Из барботера извлекают проанализированную пробу, ополаскивают его дистиллированной водой и проводят газовую экстракцию остальных трех параллельных порций пробы.

Газовую экстракцию проводят в день отбора пробы. Сорбционные трубки с экстрагированными примесями до анализа сохраняют заглушенными в эксикаторе. Трубки с пробами не следует хранить более трёх суток.

4.2.5.2. Устанавливают рабочий режим прибора

Проверяют чистоту сорбционных трубок, помещая их поочередно в испаритель хроматографа и записывая нулевую линию на шкале электрометра 20·10⁻¹² А.

Проводят хроматографический анализ. Сорбционную трубку с экстрагированными примесями помещают в испаритель хроматографа, соединенный с колонкой № 1 (см. п. 2.3.4.4.). Включают секундомер и диаграммную ленту. Также анализируют вторую трубку с параллельной пробой. Анализ 3-ей и 4-ой параллельных проб проводят на колонке № 2 (см. п. 2.3.4.4.).

4.2.5.3. Измеряют влажность аналитической пробы - см. п. 4.1.5.2.

4.2.6. Обработка результатов измерений

4.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БУТИЛАКРИЛАТА И БУТИЛМЕТАКРИЛАТА

Методика предназначена для измерения массовых концентраций БА и БМА в пробах почвы в диапазоне 0,002 - 0,1 мг/кг.

Определению не мешают: спирты C_1 - C_4 , МА, ММА, ароматические углеводороды, бензол, фенол, стирол, АК, МАК.

4.3.1. Погрешность измерения

Суммарная погрешность измерения БА не превышает 24%, БМА - 18%.

4.3.2. Метод измерения - см. п. 4.1.2.

4.3.3. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

При выполнении измерений применяются следующие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

4.3.3.1. Средства измерений - см. п. 4.1.3.1.

4.3.3.2. Вспомогательные устройства - см. п. 4.1.3.2.

4.3.3.3. Материалы - см. 4.1.3.3.

4.3.3.4. Р е а к т и в ы

Бутилакрилат, ч перегнаный	ТУ 6П - 232 - 69
Бутилметакрилат, ч неперегнаный	МРТУ 6-09-294I - 66
Твёрдый носитель хроматон <i>N</i> -AW-НМДС (0,20 - 0,25 мм) или хроматон <i>N</i> - "S-pec" или хроматон <i>N</i> AW - ДМС	
Твёрдый носитель Силохром С-80 (0,25-0,50мм)	ТУ 6-09-17-48-74
Жидкая фаза ПМС-100, ч	МРТУ 6/еУ
Жидкая фаза ПМС-4, ч	ГОСТ 15866 - 70
Жидкая фаза ПЭГА, ч.д.а.	ГОСТ 6П - 65 - 67
Хлороформ, х.ч.	ГОСТ 3160 - 5I

Диэтиловый эфир, х.ч.	ГОСТ 6265 - 52
Вода дистиллированная	ГОСТ 6709 - 72
Азот газообразный	ГОСТ 9293 - 74
Водород газообразный	ГОСТ 3022 - 77
Воздух от компрессора или сжатый в баллонах	ГОСТ II882 - 73

4.3.4. Подготовка к выполнению измерений

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы.

- 4.3.4.1. Подготовка испарителя хроматографа см. п. 2.1.4.1.
- 4.3.4.2. Подготовка хроматографических колонок см. п. 2.2.4.2.
- 4.3.4.3. Подготовка сорбционных трубок см. п. 2.1.4.3.
- 4.3.4.4. Подготовка установки для газовой экстракции см. п. 4.1.4.4.
- 4.3.4.5. Подготовка контрольной почвы см. п. 4.1.4.5.
- 4.3.4.6. Условия проведения хроматографического анализа см. п. 2.2.4.4.
- 4.3.4.7. Определение градуировочной характеристики

Для определения градуировочной характеристики БА и БМА готовят искусственные смеси контрольной почвы с растворами заданных концентраций МА и ММА в дистиллированной воде.

В мерных колбах вместимостью 50 см³ готовят в дистиллированной воде исходные растворы БА и БМА № 1 с концентрациями около 50 мг/дм³. Из исходных растворов № 1 в колбе вместимостью 200 см³ готовят исходные растворы № 2 с концентрациями БА и БМА по 1,0 мг/дм³. Из этого раствора последовательным разбавлением в колбах вместимостью 200 см³ готовят рабочие растворы в соответствии с табл. 4.4.

Готовят по 4 серии рабочих растворов каждой концентрации. Для приготовления градуировочных смесей заданных концентраций по 30 г контрольной почвы заливают 30 см³ рабочих растворов. Концентрации градуировочных смесей (мг/кг) соответствуют концентрациям рабочих растворов (мг/дм³) тех же номеров.

Готовят по 4 серии градуировочных смесей. Как рабочие растворы, так и градуировочные смеси контрольной почвы с рабочими растворами готовят непосредственно перед проведением измерений. Измерения проводят как далее описано в п. 4.3.5. Проводят по 5 параллельных измерений каждой серии каждой градуировочной смеси. На хроматограммах измеряют высоты пиков БА и Б1А и результаты измерений заносят в табл. 4.5.

4.3.5. Выполнение измерений

При выполнении измерений концентраций БА и БМА в пробах почвы проводят следующие операции:

4.3.5.1. Взвешивают по 30 г шесть порций анализируемой пробы почвы. Две порции пробы оставляют для определения коэффициента влажности Квл. Из оставшихся четырех порций пробы проводят поочередно газовую экстракцию следующим способом. В барботёр помещают 30 г пробы, заливают её 30 см³ дистиллированной воды, смесь встряхивают для перемешивания почвы с водой. К входному концу барботера подсоединяют источник газа-экстрагента, к выходному - сорбционную трубку. Включают поток газа-экстрагента и доводят его до отметки реометра 200 см³/мин. Включают секундомер и проводят газовую экстракцию в течении 15 мин. По истечении времени экстракции выключают поток газа-экстрагента и отсоединяют сорбционную трубку. Из барботёра извлекают проанализированную пробу, ополаскивают его дистиллированной водой и проводят газовую экстракцию остальных трех параллельных порций пробы.

Газовую экстракцию проводят в день отбора пробы. Сорбционные трубки с экстрагированными примесями до анализа сохраняют заглушенными в эксикаторе. Трубки с пробами можно хранить не более недели.

4.3.5.2. Прибор выводят на рабочий режим - см. п.2.4.4.4.

Проверяют чистоту сорбционных трубок. Проводят хроматографический анализ. Сорбционную трубку с экстрагированными приме-

сями помещают в испаритель хроматографа, соединенный с колонкой № I (см. п.2.4.4.4.). Включают секундомер и диаграммную ленту. Также анализируют вторую трубку с параллельной пробой. Анализ 3-ей и 4-ой параллельных проб проводят на колонке № 2 (см. п. 2.4.4.4.).

4.3.5.3. Измеряют влажность аналитической пробы -см.п.4.I,5.2.

4.3.6. Обработка результатов измерений - см. п. 4.2.6.

4.3.7. Оформление результатов измерений - см. п. 4.2.7.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Витенберг А.Г., Иоффе Б.В., Газовая экстракция в хроматографическом анализе// Л.: Химия.-1982.-28 с.
2. ГОСТ 8.207-76. Государственная система обеспечения единства измерения с многократными измерениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения.
3. ГОСТ 17.1.5.04.81. Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод.
4. ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила отбора.
5. ГОСТ 17.2.4.02-81 (СТ 2598-80). Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ в атмосфере.
6. ГОСТ 17.4.4.02.84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализа.
7. ГОСТ 17.2.01.-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов.
8. ГОСТ 17.2.6.01.-86 Охрана природы. Атмосфера. Приборы для отбора проб воздуха населенных пунктов. Общие технические требования.
9. ГОСТ 8.010-90. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к построению, содержанию и изложению документации, регламентирующей методики выполнения измерений содержания компонентов проб веществ и материалов.
10. Дмитриев М.Т., Казнина Н.И., Пинигина И.А. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. Справочник. М.: Химия. 1989. 367 с.
11. Казнина Н.И., Зиновьева Н.П. Использование калибровочных паро-газовых смесей в анализе микропримесей// Физико-химические методы в гигиенических исследованиях. Сб. науч. трудов. М.: 1983.С. 14-16
12. Ломонова Г.В. Материалы к токсикологии эфиров кислот акриловой и метакриловой с одно- и двухатомными спиртами алифатического ряда //Гигиена, промышленная токсикология и профпатология в производствах полиакрилатов и сырья для них. М, 1984. - с. 44-47.
13. Муравьева С.И., Казнина Н.И., Прохорова Е.К. Справочник по контролю вредных веществ в воздухе. М.: Химия.-1988.-319 с.

14. Р# 52.24.66—86. Руководящий документ. Методические указания. Система контроля точности результатов измерений показателей загрязненности контролируемой среды. Л.: Гидрометеоизуант. 1986.—29 с.
15. Р# 52.04.186—89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М.: Госком СССР по гидрометеорологии, Минздрав СССР. 1991. 693 с
16. Справочник по физико-химическим методам исследования объектов окружающей среды. Л.: Судостроение. 1979.—646 с.
17. Тихомиров Ю.П., Чеботарев П.А., Грузинский В.Ю., Пискарев Ю.Г. Гигиеническая оценка производств акрилатов как источников загрязнения атмосферного воздуха и регламентирование вредных веществ, содержащихся в их выбросах// Гигиена труда и охрана окружающей среды в химической промышленности. Сб. науч. трудов. 1987.—М—С. 62—65.
18. Хроматографический анализ окружающей среды. М.: Химия. 605 с.
19. Экштат Б.Я., Степаненко В.Е., Помазова Е.Н. Диффузионный метод получения малых концентраций летучих веществ в гигиенических исследованиях// Гигиена и санитария. 1976.—# 9.—С. 55—58.